


2018年 ESR 量測不確定度審查紀錄

註一 使用國際標準建議的CV%當允收標準

註二 若查不到國際標準建議，可以實際測試值CV%的2倍當允收標準

月份	QC1			QC2		
	A Mean-1	ASD	CV%	A Mean-2	ASD	CV%
Jan-18	6.97	1.36	19.5%	65.22	3.4	5.2%
Feb-18	7.14	1.56	21.8%	64.82	2.93	4.5%
Mar-18	7.22	1.72	23.8%	66.06	3.72	5.6%
Apr-18	7.44	2.12	28.5%	62.37	6.12	9.8%
May-18	6.45	1.37	21.2%	64.85	3.62	5.6%
Jun-18	7.53	2	28.6%	65.32	3.37	5.2%
Jul-18	6.56	1.31	18.7%	62.25	4.72	7.3%
Aug-18	6.32	0.75	10.7%	63.48	3.04	4.7%
Sep-18	6.28	1.51	21.5%	63.16	3.43	5.3%
Oct-18	6.85	1.77	25.3%	64.53	3.30	5.1%
Nov-18	6.04	1.48	21.1%	64.57	3.74	5.8%
Dec-18	6.68	1.85	26.5%	62.62	2.95	4.6%

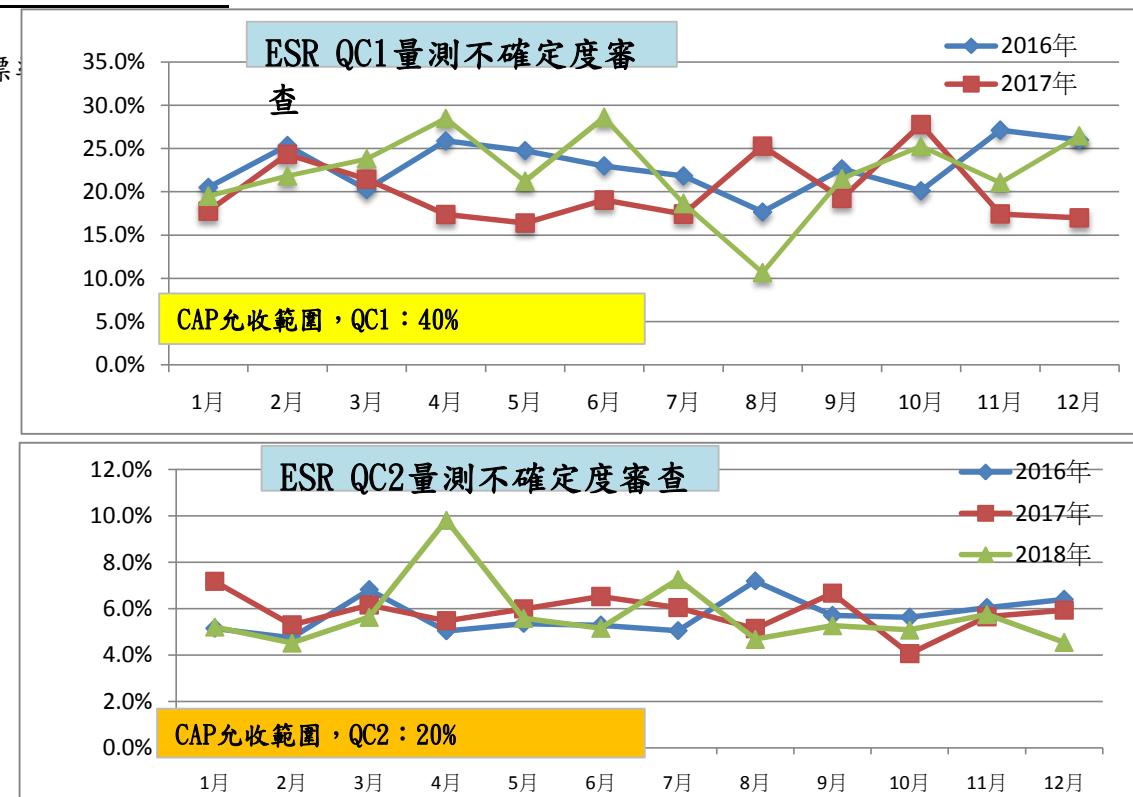

QC1-CV	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	月平均	允收範圍	審查結果
2016年	20.5%	25.4%	20.3%	25.9%	24.8%	23.0%	21.9%	17.7%	22.7%	20.1%	27.1%	26.0%	22.9%	<40%	合格
2017年	17.8%	24.3%	21.5%	17.4%	16.4%	19.1%	17.4%	25.3%	19.2%	27.8%	17.5%	17.0%	20.1%	<40%	合格
2018年	19.5%	21.8%	23.8%	28.5%	21.2%	28.6%	18.7%	10.7%	21.5%	25.3%	21.1%	26.5%	22.3%	<40%	合格

QC2-CV	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	月平均	允收範圍	審查結果
2016年	5.2%	4.8%	6.8%	5.0%	5.4%	5.3%	5.1%	7.2%	5.7%	5.6%	6.1%	6.4%	5.7%	<20%	合格
2017年	7.2%	5.3%	6.2%	5.5%	6.0%	6.5%	6.0%	5.1%	6.7%	4.1%	5.7%	5.9%	5.8%	<20%	合格
2018年	5.2%	4.5%	5.6%	9.8%	5.6%	5.2%	7.3%	4.7%	5.3%	5.1%	5.8%	4.6%	5.7%	<20%	合格

審查2018年ESR量測不確定度紀錄

(CAP允收範圍，QC1：40%、QC2：20%)

結果：經審查符合CAP允收範圍。

科主任：

醫檢主任：

醫檢組長：