

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer : PHCbi ; Model No. : MPF-DU302VX-PA ; Serial No. : 19070046

THERMOMETER : Manufacturer : KIMO ; Model No. : KTT220-0 ; Serial No. : 2K190114208 ; Channel No. : 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : -80± 10 °C

DATE : 31,Dec 2020 ~ 29, Jan 2021



統計表

| #1 | |
|--------|---------|
| 最小 T | -81.43 |
| 最小 t | -81.43 |
| 最大值 T | -79.24 |
| 最大值 t | -79.24 |
| 平均值 T | -80.187 |
| 平均值 t | -80.187 |
| 標準偏差 T | 0.474 |
| 標準偏差 t | 0.474 |
| MKT T | -80.188 |
| MKT t | -80.188 |

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:以備品溫度記錄器(12010863)執行溫度記錄

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer : PHCbi ; Model No. : MPF-DU302VX-PA; Serial No. : 19070046

THERMOMETER : Manufacturer : KIMO; Model No.: KTT220-0 ; Serial No. : 2K190114208 ; Channel No. : 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : -80± 10 °C

DATE : 29, Jan 2021 ~ 26, Feb 2021



統計表

| | #1 |
|--------|---------|
| 最小 T | -80.96 |
| 最小 t | -80.96 |
| 最大值 T | -79.12 |
| 最大值 t | -79.12 |
| 平均值 T | -80.129 |
| 平均值 t | -80.129 |
| 標準偏差 T | 0.442 |
| 標準偏差 t | 0.442 |
| MKT T | -80.13 |
| MKT t | -80.13 |

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 備品溫度記錄器(12010863)於2021年2月26日下載溫度後送校，更換回(2K190114208)

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer : PHCbi ; Model No. : MPF-DU302VX-PA; Serial No. : 19070046

THERMOMETER : Manufacturer : KIMO; Model No.: KT220-0 ; Serial No. : 2K190114208 ; Channel No. : 1


REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : -80± 10 °C

DATE : 26, Feb 2021 ~ 31, Mar 2021



2K190114208

| v1 [°C] | | | | |
|---------|-------|--------|------|--------|
| Min | Max | Avg | Sd | MKT |
| -80.9 | -77.5 | -79.99 | 0.45 | -79.96 |



Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer : PHCbi ; Model No. : MPF-DU302VX-PA ; Serial No. : 19070046

THERMOMETER : Manufacturer : KIMO ; Model No. : KTT220-0 ; Serial No. : 2K190114208 ; Channel No. : 1


REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : -80± 10 °C

DATE : 31, Mar 2021 ~ 29, Apr 2021



2K190114208

| v1 [°C] | | | | |
|---------|-------|--------|------|--------|
| Min | Max | Avg | Sd | MKT |
| -80.9 | -78.7 | -80.04 | 0.46 | -80.01 |



Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer : PHCbi ; Model No. : MPF-DU302VX-PA; Serial No. : 19070046

THERMOMETER : Manufacturer : KIMO; Model No.: KTT220-0 ; Serial No.

; Channel No. : 1


REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : -80± 10 °C

DATE : 29, Apr 2021 ~ 31, May 2021



2K190114208

| | | | | |
|---------|-------|--------|------|--------|
| v1 [°C] | | | | |
| Min | Max | Avg | Sd | MKT |
| -81.0 | -76.1 | -80.09 | 0.48 | -80.06 |



Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer : PHCbi ; Model No. : MPF-DU302VX-PA; Serial No. : 19070046

THERMOMETER : Manufacturer : KIMO; Model No.: KTT220-0 ; Serial No. : 2K190114208; Channel No. : 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : -80± 10 °C

DATE : 31, May 2021 ~ 30, Jun 2021

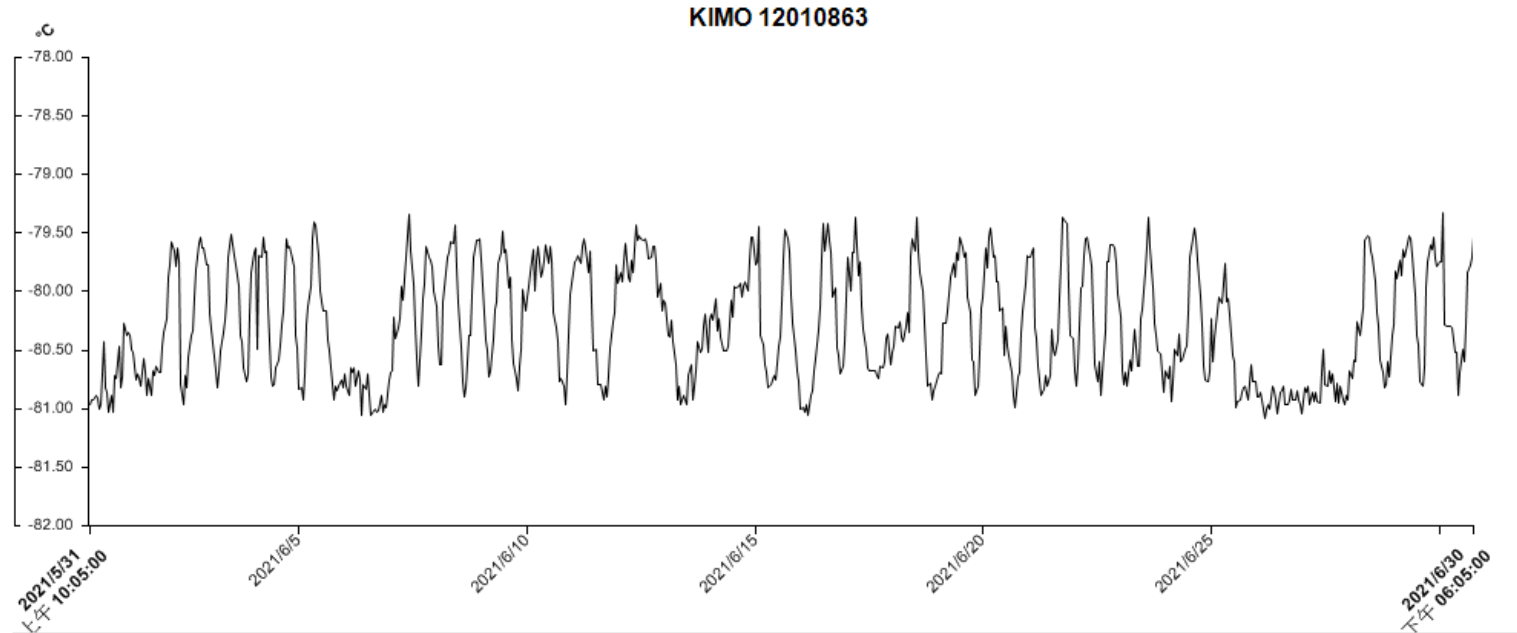

統計表

| #1 | |
|--------|---------|
| 最小 T | -81.08 |
| 最小 t | -81.08 |
| 最大值 T | -79.33 |
| 最大值 t | -79.33 |
| 平均值 T | -80.295 |
| 平均值 t | -80.295 |
| 標準偏差 T | 0.481 |
| 標準偏差 t | 0.481 |
| MKT T | -80.296 |
| MKT t | -80.296 |

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

本溫度記錄器(2K190114208)於2021年5月31日送校，2021年6月28日完成校正，期間以備品溫度記錄器(12010863)暫代。

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer : PHCbi ; Model No. : MPF-DU302VX-PA; Serial No. : 19070046

THERMOMETER : Manufacturer : KIMO; Model No.: KTT220-0 ; Serial No. : 2K190114208; Channel No. : 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : $-80 \pm 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$

DATE : 30, Jun 2021 ~ 30, Jul 2021

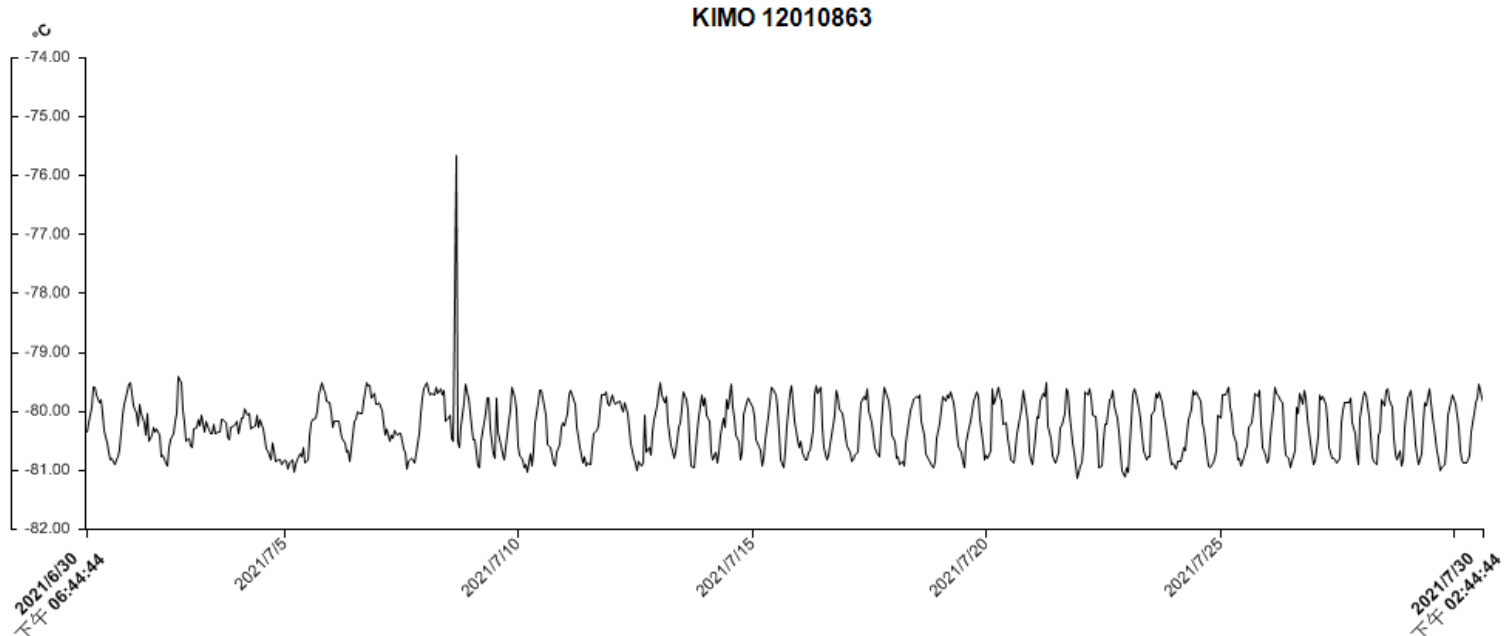

統計表

| #1 | |
|--------|---------|
| 最小 T | -81.13 |
| 最小 t | -81.13 |
| 最大值 T | -75.66 |
| 最大值 t | -75.66 |
| 平均值 T | -80.266 |
| 平均值 t | -80.266 |
| 標準偏差 T | 0.469 |
| 標準偏差 t | 0.469 |
| MKT T | -80.267 |
| MKT t | -80.267 |

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

本溫度記錄器(2K190114208)於2021年5月31日送校，2021年6月28日完成校正，期間以備品溫度記錄器(12010863)暫代。

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer : PHCbi ; Model No. : MPF-DU302VX-PA; Serial No. : 19070046

THERMOMETER : Manufacturer : KIMO; Model No.: KTT220-0 ; Serial No. : 2K190114208; Channel No. : 1


REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : -80± 10 °C

DATE : 30, Jul 2021 ~ 31, Aug 2021



2K190114208

| v1 [°C] | | | | |
|---------|-------|--------|------|--------|
| Min | Max | Avg | Sd | MKT |
| -81.0 | -75.4 | -80.17 | 0.50 | -80.14 |

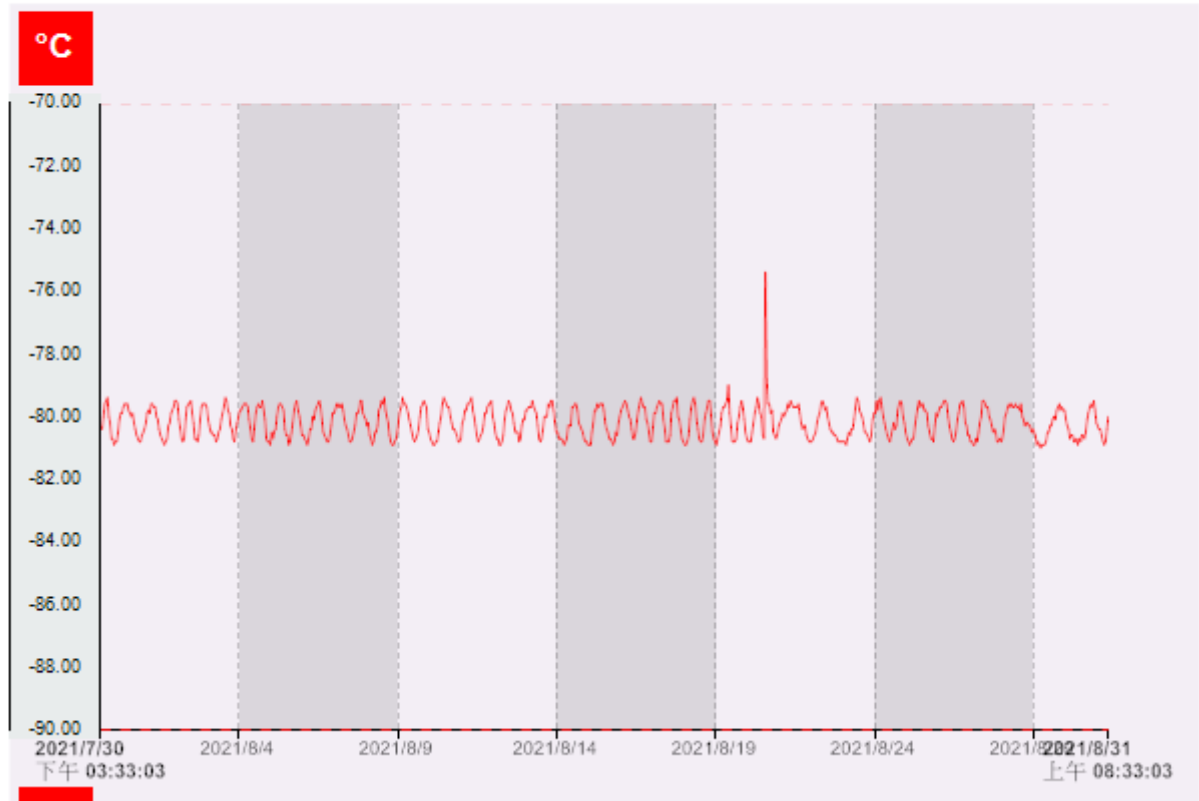

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer : PHCbi ; Model No. : MPF-DU302VX-PA; Serial No. : 19070046

THERMOMETER : Manufacturer : KIMO; Model No.: KTT220-0 ; Serial No. : 2K190114208; Channel No. : 1


REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : -80± 10 °C

DATE : 31, Aug 2021 ~ 30, Sep 2021



2K190114208

v1 [°C]
Min Max Avg Sd MKT
-81.0 -77.4 -80.21 0.49 -80.18



Comment: 因下載溫度用之筆電的時間有誤差，此月份溫度記錄之開始與結束時間比實際時間晚3hr

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer : PHCbi ; Model No. : MPF-DU302VX-PA; Serial No. : 19070046

THERMOMETER : Manufacturer : KIMO; Model No.: KTT220-0 ; Serial No. : 2K190114208; Channel No. : 1


REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : -80± 10 °C

DATE : 30, Sep 2021 ~ 29, Oct 2021



2K190114208

| v1 [°C] | | | | |
|---------|-------|--------|------|--------|
| Min | Max | Avg | Sd | MKT |
| -81.0 | -78.4 | -80.22 | 0.47 | -80.19 |

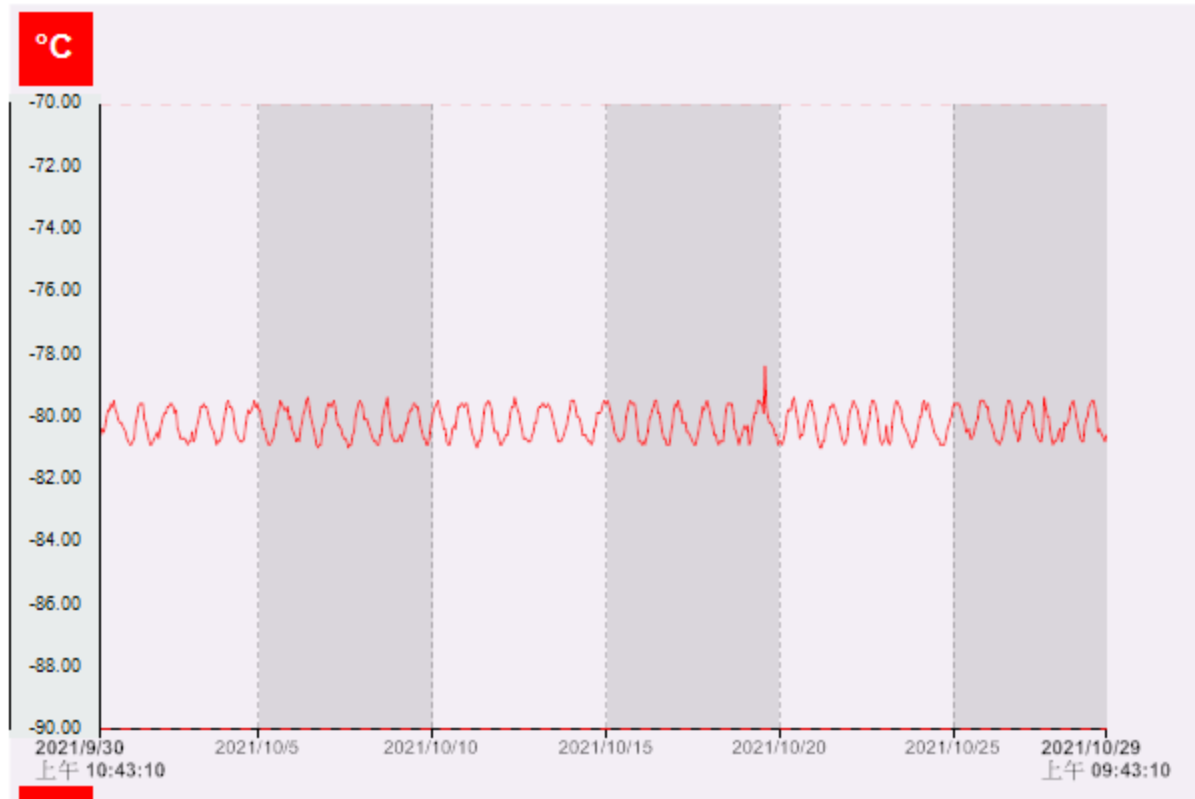

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer : PHCbi ; Model No. : MPF-DU302VX-PA; Serial No. : 19070046

THERMOMETER : Manufacturer : KIMO; Model No.: KTT220-0 ; Serial No. : 2K190114208; Channel No. : 1


REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : -80 ± 10 °C

DATE : 29, Oct 2021 ~ 30, Nov 2021



2K190114208

| v1 [°C] | | | | |
|---------|-------|--------|------|--------|
| Min | Max | Avg | Sd | MKT |
| -81.0 | -76.2 | -80.14 | 0.56 | -80.10 |



Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer : PHCbi ; Model No. : MPF-DU302VX-PA; Serial No. : 19070046

THERMOMETER : Manufacturer : KIMO; Model No.: KTT220-0 ; Serial No. : 2K190114208; Channel No. : 1


REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : $-80 \pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$

DATE : 30, Nov 2021 ~ 29, Dec 2021



2K190114208

— v1 [°C]
Min Max Avg Sd MKT
-81.0 -77.6 -80.16 0.50 -80.13



Comment: