

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy

FREEZER : Manufacturer ; PANASONIC ; Model No.: MDF-U334-PT ; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO ; Model No. : KTT-310 ; Serial No. : 13051667 ; Channel No. : 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 31,Dec 2020~29,Jan 2021



統計表

	#1
最小 T	-19.96
最小 t	-19.96
最大值 T	-17.83
最大值 t	-17.83
平均值 T	-18.892
平均值 t	-18.892
標準偏差 T	0.602
標準偏差 t	0.602
MKT T	-18.893
MKT t	-18.893

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy

FREEZER : Manufacturer ; PANASONIC ; Model No.: MDF-U334-PT ; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO ; Model No. : KTT-310 ; Serial No. : 13051667 ; Channel No. : 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 29,Jan 2021 ~26,Feb 2021



統計表

	#1
最小 T	-20.07
最小 t	-20.07
最大值 T	-17.88
最大值 t	-17.88
平均值 T	-18.971
平均值 t	-18.971
標準偏差 T	0.62
標準偏差 t	0.62
MKT T	-18.972
MKT t	-18.972

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy


FREEZER : Manufacturer ; PANASONIC ; Model No.: MDF-U334-PT ; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO ; Model No_ : KTT-310 ; Serial No. : 13051667 ; Channel No. : 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 26, Feb 2021 ~ 31, Mar 2021

KIMO 1305 1667



統計表

#1	
最小 T	-20.18
最小 t	-20.18
最大值 T	-17.90
最大值 t	-17.90
平均值 T	-19.044
平均值 t	-19.044
標準偏差 T	0.639
標準偏差 t	0.639
MKT T	-19.046
MKT t	-19.046

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy

FREEZER : Manufacturer ; PANASONIC ; Model No.: MDF-U334-PT ; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO ; Model No_ : KTT-310 ; Serial No. : 13051667 ; Channel No. : 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 31,Mar 2021~ 29,Apr 2021

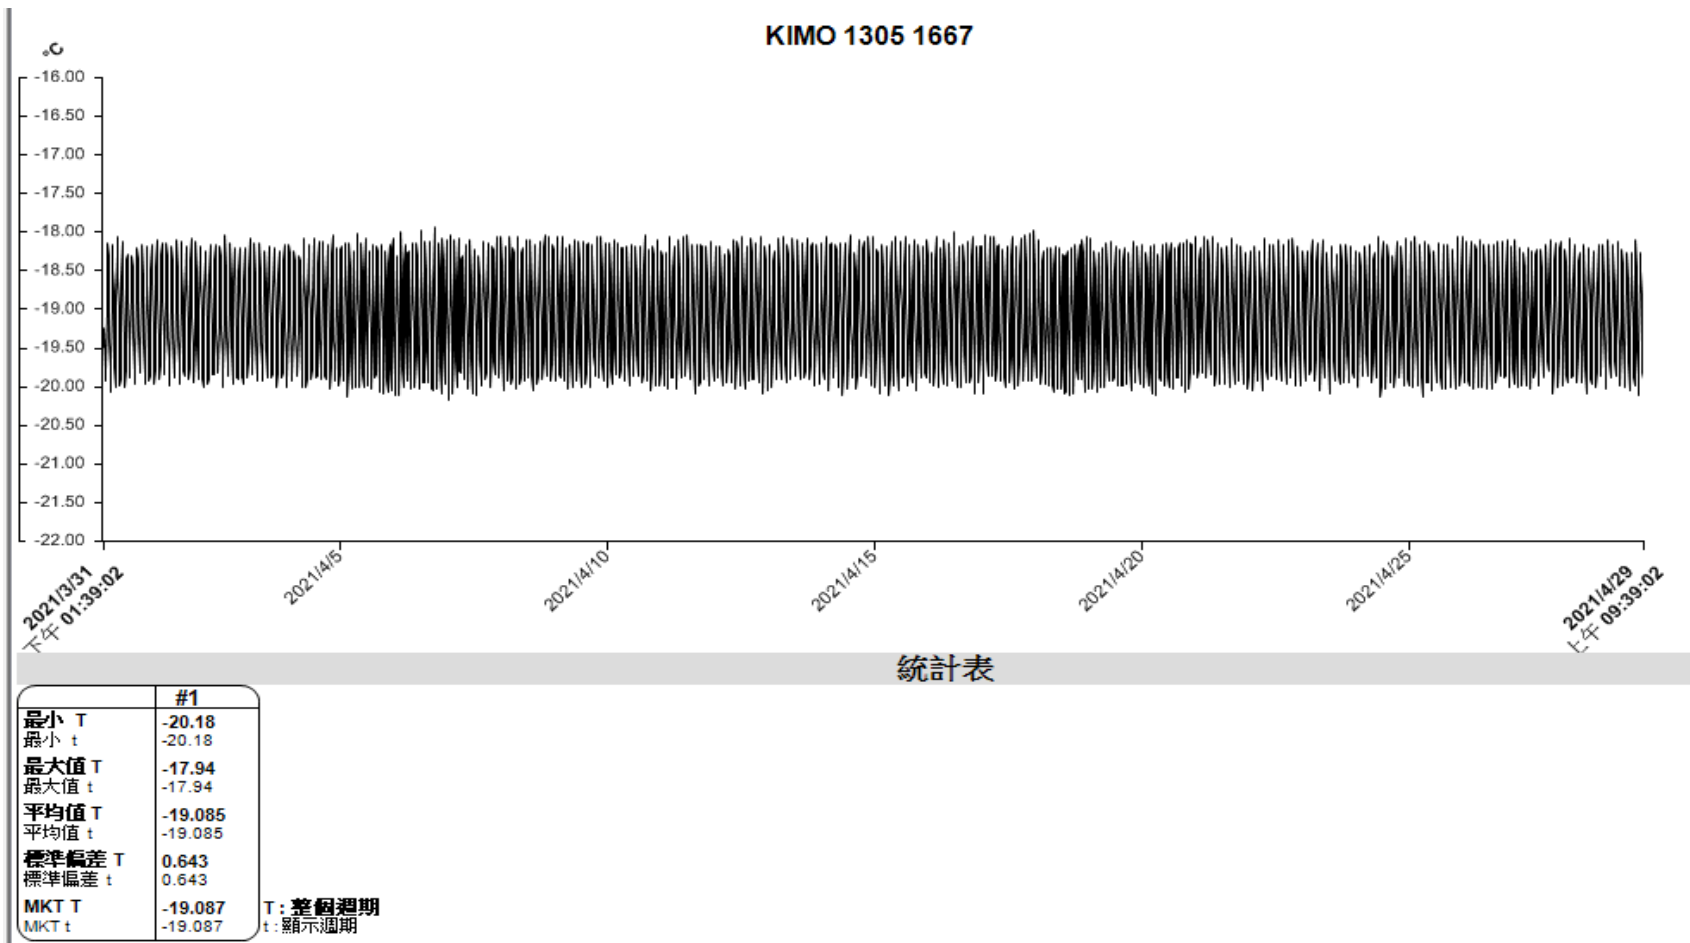

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 29, Apr 2021 ~ 31, May 2021



統計表

#1	
最小 T	-20.14
最小 t	-20.14
最大值 T	-17.91
最大值 t	-17.91
平均值 T	-19.057
平均值 t	-19.057
標準偏差 T	0.624
標準偏差 t	0.624
MKT T	-19.059
MKT t	-19.059

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 31, May 2021 ~ 30, Jun 2021



統計表

#1	
最小 T	-20.41
最小 t	-20.41
最大值 T	-17.97
最大值 t	-17.97
平均值 T	-19.157
平均值 t	-19.157
標準偏差 T	0.663
標準偏差 t	0.663
MKT T	-19.159
MKT t	-19.159

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 30, Jun 2021 ~ 30, Jul 2021



統計表

#1	
最小 T	-20.37
最小 t	-20.37
最大值 T	-18.02
最大值 t	-18.02
平均值 T	-19.212
平均值 t	-19.212
標準偏差 T	0.674
標準偏差 t	0.674
MKT T	-19.214
MKT t	-19.214

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 30, Jul 2021 ~ 31, Aug 2021

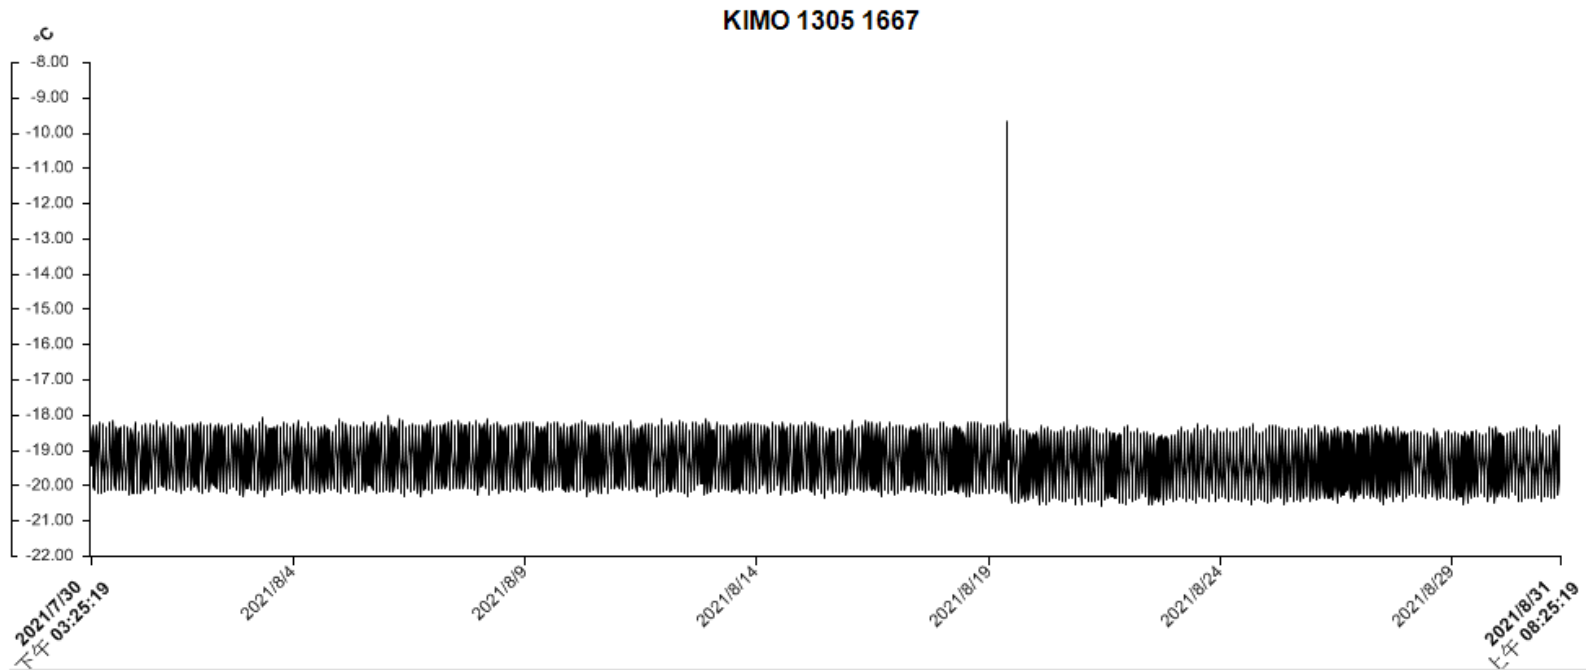

統計表

#1	
最小 T	-20.56
最小 t	-20.56
最大值 T	-9.67
最大值 t	-9.67
平均值 T	-19.285
平均值 t	-19.285
標準偏差 T	0.707
標準偏差 t	0.707
MKT T	-19.287
MKT t	-19.287

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 2021年8月19日進行溫控網遊校，目前冷凍櫃內無存放試驗藥品。

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 31, Aug 2021 ~ 30, Sep 2021



統計表

#1	
最小 T	-20.84
最小 t	-20.84
最大值 T	-16.67
最大值 t	-16.67
平均值 T	-19.496
平均值 t	-19.496
標準偏差 T	0.711
標準偏差 t	0.711
MKT T	-19.498
MKT t	-19.498

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 因下載溫度用之筆電的時間有誤差，此月份溫度記錄之開始與結束時間比實際時間晚3hr 9

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 30, Sep 2021 ~ 29, Oct 2021



統計表

#1	
最小 T	-20.84
最小 t	-20.84
最大值 T	-18.38
最大值 t	-18.38
平均值 T	-19.585
平均值 t	-19.585
標準偏差 T	0.697
標準偏差 t	0.697
MKT T	-19.587
MKT t	-19.587

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 29, Oct 2021 ~ 01, Nov 2021

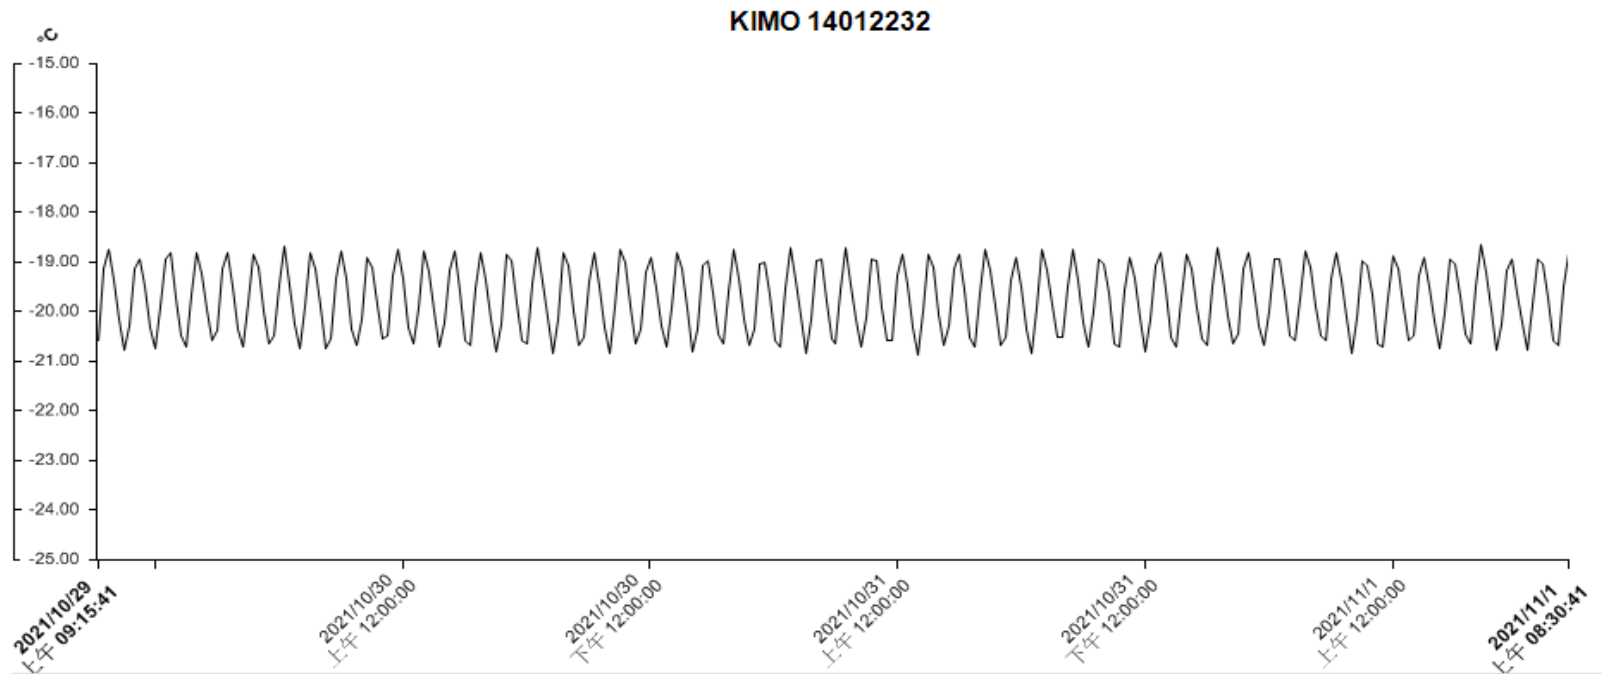

統計表

	#1
最小 T	-20.88
最小 t	-20.88
最大值 T	-18.64
最大值 t	-18.64
平均值 T	-19.766
平均值 t	-19.766
標準偏差 T	0.69
標準偏差 t	0.69
MKT T	-19.767
MKT t	-19.767

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 本溫度記錄器(13051667)於2021年10月29日送校，期間以備品溫度記錄器(14012232)暫代¹¹

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1


FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 01, Nov 2021 ~ 30, Nov 2021



KIMO 2K160903197

— v1 [°C]
Min Max Avg Sd MKT
-20.8 -14.7 -19.57 0.75 -19.53



Comment:本溫度記錄器(13051667)送校期間暫代之備品(14012232)於2021年11月1日電量顯示異常，以另一備品(2K160903197)暫代；2021年11月4日進行冰箱本體確效，目前冷凍櫃內無存放試驗藥品

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1


FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 30, Nov 2021 ~ 23, Dec 2021



KIMO 2K160903197

v1 [°C]
Min Max Avg Sd MKT
-20.7 -18.3 -19.52 0.72 -19.48

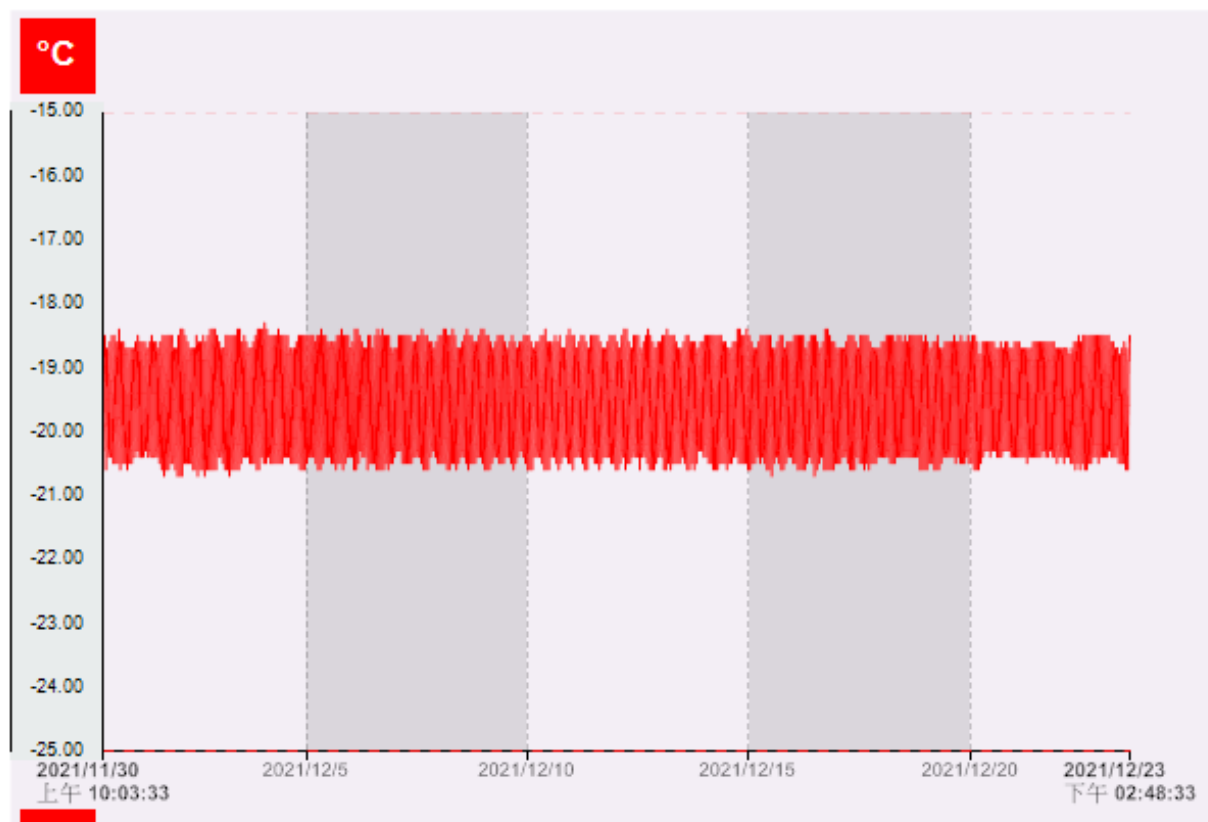

Comment:本溫度記錄器(13051667)送校完成，且暫代之備品(2K160903197)需送校，故提前於2021/12/23換回13051667

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 23, Dec 2021 ~ 29, Dec 2021



統計表

	#1
最小 T	-20.81
最小 t	-20.81
最大值 T	-18.45
最大值 t	-18.45
平均值 T	-19.568
平均值 t	-19.568
標準偏差 T	0.67
標準偏差 t	0.67
MKT T	-19.569
MKT t	-19.569

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: