

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy


FREEZER : Manufacturer ; SANYO ; Model No.: MDF-U537D ; Serial No.: 10040043 ; Chamber : top

THERMOMETER : KIMO ; Model No. : KTT-310 ; Serial No. : 11050427 ; Channel No. : 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 31,DEC 2020 ~ 29,Jan 2021

KIMO 11050427



統計表

	#1
最小 T	-24.06
最小 t	-24.06
最大值 T	-18.04
最大值 t	-18.04
平均值 T	-20.31
平均值 t	-20.31
標準偏差 T	1.325
標準偏差 t	1.325
MKT T	-20.317
MKT t	-20.317

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy


FREEZER : Manufacturer ; SANYO ; Model No.: MDF-U537D ; Serial No.: 10040043 ; Chamber : top

THERMOMETER : KIMO ; Model No. : KTT-310 ; Serial No. : 11050427 ; Channel No. : 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 29,Jan 2021 ~26,Feb 2021

KIMO 11050427



統計表

	#1
最小 T	-24.12
最小 t	-24.12
最大值 T	-17.85
最大值 t	-17.85
平均值 T	-20.252
平均值 t	-20.252
標準偏差 T	1.255
標準偏差 t	1.255
MKT T	-20.258
MKT t	-20.258

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy

FREEZER : Manufacturer ; SANYO ; Model No.: MDF-U537D ; Serial No.: 10040043 ; Chamber : top

THERMOMETER : KIMO ; Model No. : KTT-310 ; Serial No. : 11050427 ; Channel No. : 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 26, Feb 2021 ~ 31, Mar 2021



統計表

	#1
最小 T	-23.80
最小 t	-23.80
最大值 T	-17.92
最大值 t	-17.92
平均值 T	-20.165
平均值 t	-20.165
標準偏差 T	1.213
標準偏差 t	1.213
MKT T	-20.17
MKT t	-20.17

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy


FREEZER : Manufacturer ; SANYO ; Model No.: MDF-U537D ; Serial No.: 10040043 ; Chamber : top

THERMOMETER : KIMO ; Model No. : KTT-310 ; Serial No. : 11050427 ; Channel No. : 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 31,Mar 2021~ 29,Apr 2021

KIMO 11050427



統計表

#1	
最小 T	-23.90
最小 t	-23.90
最大值 T	-17.62
最大值 t	-17.62
平均值 T	-20.127
平均值 t	-20.127
標準偏差 T	1.179
標準偏差 t	1.179
MKT T	-20.132
MKT t	-20.132

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building, Clinical Research Pharmacy


FREEZER : Manufacturer; SANYO; Model No.: MDF-U537D; Serial No.: 10040043; Chamber : top

THERMOMETER : KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 11050427; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 29, Apr 2021 ~ 31, May 2021

KIMO 11050427

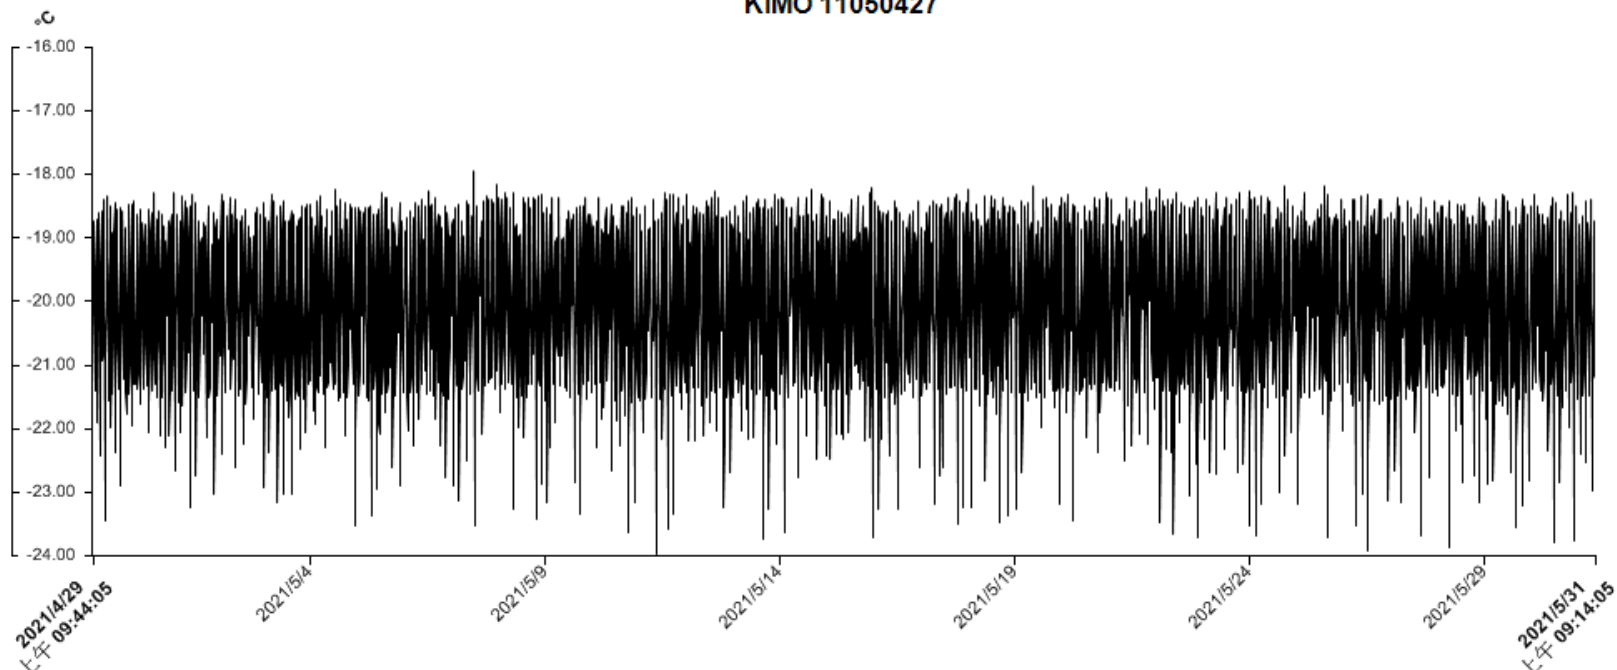

統計表

	#1
最小 T	-23.98
最小 t	-23.98
最大值 T	-17.94
最大值 t	-17.94
平均值 T	-20.156
平均值 t	-20.156
標準偏差 T	1.195
標準偏差 t	1.195
MKT T	-20.162
MKT t	-20.162

T : 整個週期
t : 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building, Clinical Research Pharmacy

FREEZER : Manufacturer; SANYO; Model No.: MDF-U537D; Serial No.: 10040043; Chamber : top

THERMOMETER : KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 11050427; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 31, May 2021 ~ 30, Jun 2021



統計表

#1	
最小 T	-23.83
最小 t	-23.83
最大值 T	-18.16
最大值 t	-18.16
平均值 T	-20.142
平均值 t	-20.142
標準偏差 T	1.187
標準偏差 t	1.187
MKT T	-20.148
MKT t	-20.148

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building, Clinical Research Pharmacy


FREEZER : Manufacturer; SANYO; Model No.: MDF-U537D; Serial No.: 10040043; Chamber : top

THERMOMETER : KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 11050427; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 30, Jun 2021 ~ 30, Jul 2021

KIMO 11050427



統計表

	#1
最小 T	-23.88
最小 t	-23.88
最大值 T	-16.98
最大值 t	-16.98
平均值 T	-20.196
平均值 t	-20.196
標準偏差 T	1.231
標準偏差 t	1.231
MKT T	-20.201
MKT t	-20.201

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building, Clinical Research Pharmacy


FREEZER : Manufacturer; SANYO; Model No.: MDF-U537D; Serial No.: 10040043; Chamber : top

THERMOMETER : KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 11050427; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 30, Jul 2021 ~ 31, Aug 2021

KIMO 14012232



統計表

	#1
最小 T	-24.16
最小 t	-24.16
最大值 T	-18.42
最大值 t	-18.42
平均值 T	-20.454
平均值 t	-20.454
標準偏差 T	1.242
標準偏差 t	1.242
MKT T	-20.46
MKT t	-20.46

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 本溫度記錄器(11050427)於2021年8月3日送校，期間以備品溫度記錄器(14012232)暫代。

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building, Clinical Research Pharmacy


FREEZER : Manufacturer; SANYO; Model No.: MDF-U537D; Serial No.: 10040043; Chamber : top

THERMOMETER : KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 11050427; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 31, Aug 2021 ~ 30, Sep 2021

KIMO 14012232



統計表

	#1
最小 T	-23.90
最小 t	-23.90
最大值 T	-18.33
最大值 t	-18.33
平均值 T	-20.464
平均值 t	-20.464
標準偏差 T	1.25
標準偏差 t	1.25
MKT T	-20.471
MKT t	-20.471

T: 整個週期

t: 顯示週期

Comment: 因下載溫度用之筆電的時間有誤差，此月份溫度記錄之開始與結束時間比實際時間晚3hr；
本溫度記錄器(11050427)於2021年8月3日送校，期間以備品溫度記錄器(14012232)暫代。

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building, Clinical Research Pharmacy


FREEZER : Manufacturer; SANYO; Model No.: MDF-U537D; Serial No.: 10040043; Chamber : top

THERMOMETER : KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 11050427; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 30, Sep 2021 ~ 29, Oct 2021

KIMO 11050427



統計表

#1	
最小 T	-23.43
最小 t	-23.43
最大值 T	-16.86
最大值 t	-16.86
平均值 T	-20.099
平均值 t	-20.099
標準偏差 T	1.133
標準偏差 t	1.133
MKT T	-20.104
MKT t	-20.104

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building, Clinical Research Pharmacy


FREEZER : Manufacturer; SANYO; Model No.: MDF-U537D; Serial No.: 10040043; Chamber : top

THERMOMETER : KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 11050427; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 29, Oct 2021 ~ 30, Nov 2021

KIMO 11050427



統計表

#1	
最小 T	-23.34
最小 t	-23.34
最大值 T	-18.19
最大值 t	-18.19
平均值 T	-20.079
平均值 t	-20.079
標準偏差 T	1.087
標準偏差 t	1.087
MKT T	-20.084
MKT t	-20.084

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building, Clinical Research Pharmacy


FREEZER : Manufacturer; SANYO; Model No.: MDF-U537D; Serial No.: 10040043; Chamber : top

THERMOMETER : KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 11050427; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 30, Nov 2021 ~ 29, Dec 2021

KIMO 11050427



統計表

	#1
最小 T	-23.40
最小 t	-23.40
最大值 T	-18.23
最大值 t	-18.23
平均值 T	-20.096
平均值 t	-20.096
標準偏差 T	1.116
標準偏差 t	1.116
MKT T	-20.1
MKT t	-20.1

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: