

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


**PHARMACY** : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

**FREEZER** : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

**THERMOMETER** : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

**FREEZER TEMPERATURE RANGE** : -15~-25°C

**DATE** : 29, Dec 2021 ~ 25, Jan 2022



統計表

#1	
最小 T	-20.80
最小 t	-20.80
最大值 T	-18.46
最大值 t	-18.46
平均值 T	-19.606
平均值 t	-19.606
標準偏差 T	0.667
標準偏差 t	0.667
MKT T	-19.608
MKT t	-19.608

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 25, Jan 2022 ~ 24, Feb 2022



統計表

#1	
最小 T	-20.65
最小 t	-20.65
最大值 T	-18.38
最大值 t	-18.38
平均值 T	-19.532
平均值 t	-19.532
標準偏差 T	0.646
標準偏差 t	0.646
MKT T	-19.533
MKT t	-19.533

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.


FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 24, Feb 2022 ~ 31, Mar 2022

KIMO 1305 1667



統計表

	#1
最小 T	-20.62
最小 t	-20.62
最大值 T	-18.39
最大值 t	-18.39
平均值 T	-19.505
平均值 t	-19.505
標準偏差 T	0.624
標準偏差 t	0.624
MKT T	-19.506
MKT t	-19.506

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

**FREEZER** : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

**THERMOMETER** : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

**FREEZER TEMPERATURE RANGE** : -15~-25°C

**DATE** : 31, Mar 2022 ~ 29, Apr 2022



統計表

#1	
最小 T	-20.65
最小 t	-20.65
最大值 T	-18.46
最大值 t	-18.46
平均值 T	-19.506
平均值 t	-19.506
標準偏差 T	0.604
標準偏差 t	0.604
MKT T	-19.507
MKT t	-19.507

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

**FREEZER** : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

**THERMOMETER** : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

**FREEZER TEMPERATURE RANGE** : -15~-25°C

**DATE** : 29, Apr 2022 ~ 30, May 2022



統計表

#1	
最小 T	-20.89
最小 t	-20.89
最大值 T	-18.12
最大值 t	-18.12
平均值 T	-19.671
平均值 t	-19.671
標準偏差 T	0.622
標準偏差 t	0.622
MKT T	-19.673
MKT t	-19.673

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 30, May 2022 ~ 28, Jun 2022



統計表

	#1
最小 T	-21.00
最小 t	-21.00
最大值 T	-18.75
最大值 t	-18.75
平均值 T	-19.865
平均值 t	-19.865
標準偏差 T	0.62
標準偏差 t	0.62
MKT T	-19.866
MKT t	-19.866

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.


FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 28, Jun 2022 ~ 07, Jul 2022

KIMO 1305 1667

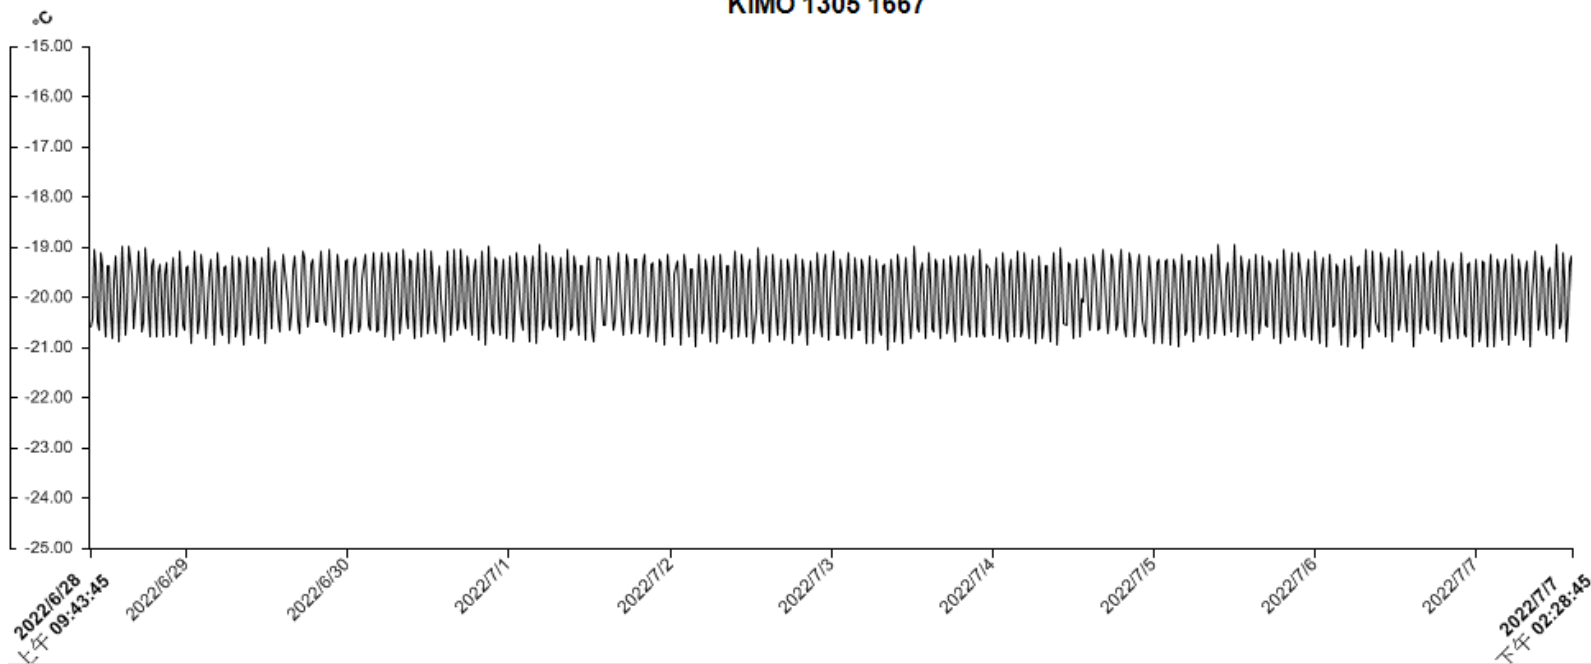

統計表

	#1
最小 T	-21.02
最小 t	-21.02
最大值 T	-18.93
最大值 t	-18.93
平均值 T	-19.949
平均值 t	-19.949
標準偏差 T	0.614
標準偏差 t	0.614
MKT T	-19.95
MKT t	-19.95

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment: 於2022年7月7日更換溫度記錄器的感溫線，調整感溫探頭。目前未存放藥品。

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

**PHARMACY** : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.


**FREEZER** : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

**THERMOMETER** : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

**FREEZER TEMPERATURE RANGE** : -15~-25°C

**DATE** : 08, Jul 2022 ~ 29, Jul 2022

KIMO 1305 1667

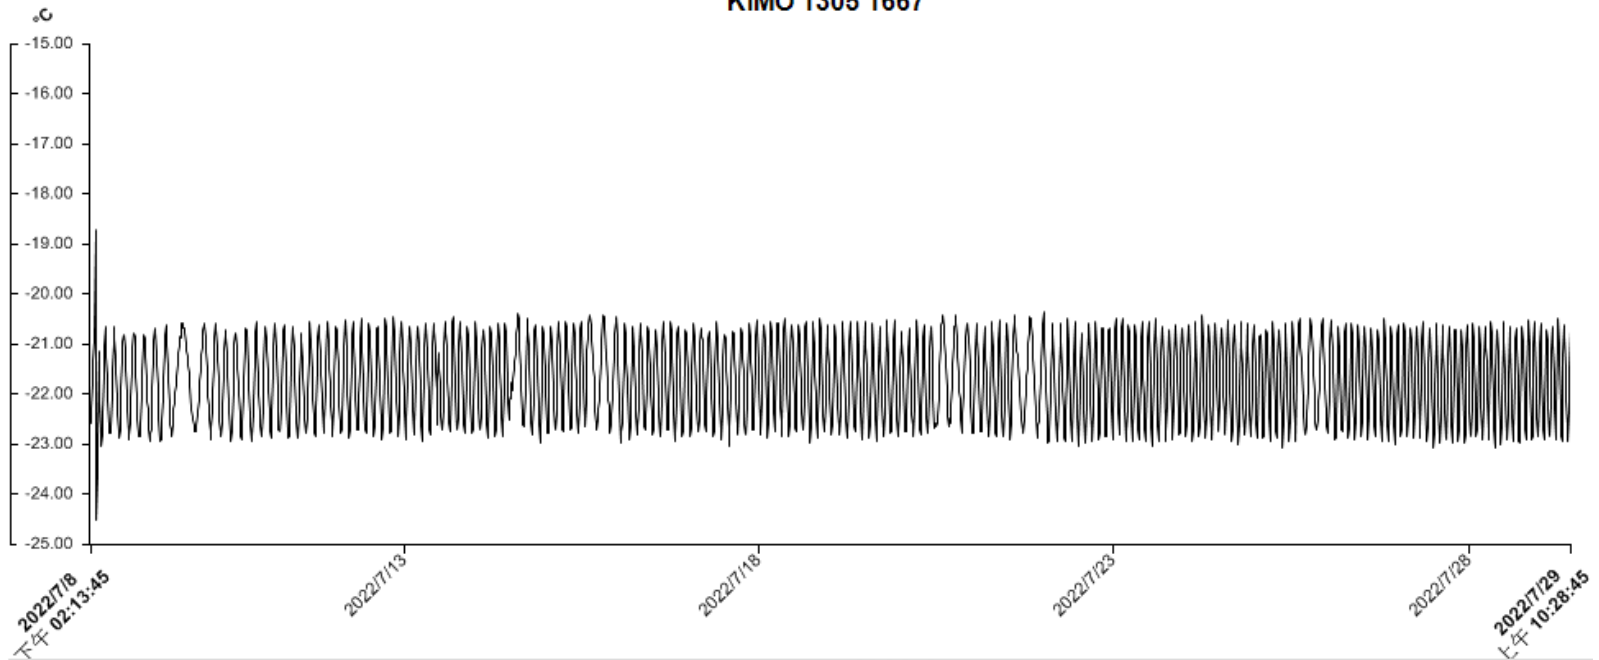

統計表

#1	
最小 T	-24.51
最小 t	-24.51
最大值 T	-18.70
最大值 t	-18.70
平均值 T	-21.725
平均值 t	-21.725
標準偏差 T	0.788
標準偏差 t	0.788
MKT T	-21.728
MKT t	-21.728

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment: 於2022年7月7日除霜，於2022年7月8日重啟。目前未存放藥品。



# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


**PHARMACY** : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

**FREEZER** : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

**THERMOMETER** : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

**FREEZER TEMPERATURE RANGE** : -15~-25°C

**DATE** : 29, Jul 2022 ~ 31, Aug 2022



統計表

	#1
最小 T	-23.11
最小 t	-23.11
最大值 T	-18.44
最大值 t	-18.44
平均值 T	-20.511
平均值 t	-20.511
標準偏差 T	1.225
標準偏差 t	1.225
MKT T	-20.517
MKT t	-20.517

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


**PHARMACY :** B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

**FREEZER :** Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

**THERMOMETER :** KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

**FREEZER TEMPERATURE RANGE :** -15~-25°C

**DATE :** 31, Aug 2022 ~ 30, Sep 2022

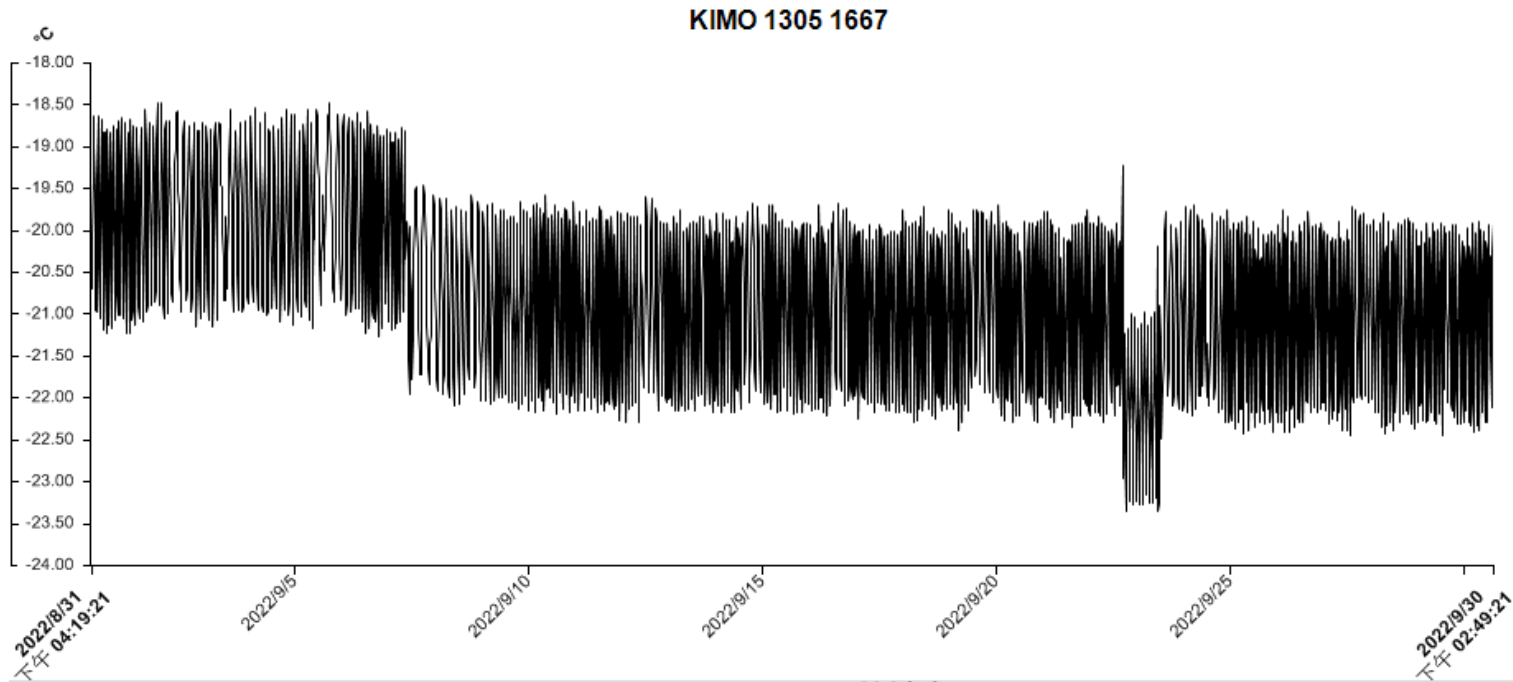

統計表

		#1
最小 T		-23.35
最小 t		-23.35
最大值 T		-18.48
最大值 t		-18.48
平均值 T		-20.758
平均值 t		-20.758
標準偏差 T		0.966
標準偏差 t		0.966
MKT T	T: 整個週期	-20.762
MKT t	t: 顯示週期	-20.762

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


**PHARMACY** : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

**FREEZER** : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

**THERMOMETER** : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

**FREEZER TEMPERATURE RANGE** : -15~-25°C

**DATE** : 30, Sep 2022 ~ 13, Oct 2022



## 統計表

	#1
最小 T	-22.86
最小 t	-22.86
最大值 T	-18.81
最大值 t	-18.81
平均值 T	-21.054
平均值 t	-21.054
標準偏差 T	0.824
標準偏差 t	0.824
MKT T	-21.057
MKT t	-21.057

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment: 本溫度記錄器(1305 1667)於2022年10月13日送校，期間以備品溫度記錄器(1D220605898)暫代。

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No.: KTT-220-O; Serial No.: 1D220605898; Channel No.: 1


FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 13, Oct 2022 ~ 28, Oct 2022



1D220605898

v1 [°C]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT
-22.4	-19.6	-21.04	0.85	-20.98



Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

FREEZER : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

THERMOMETER : KIMO; Model No.: KTT-220-O; Serial No.: 1D220605898; Channel No.: 1


FREEZER TEMPERATURE RANGE : -15~-25°C

DATE : 28, Oct 2022 ~ 28, Nov 2022



1D220605898

— v1 [°C]  
Min Max Avg Sd MKT  
-22.7 -19.8 -21.18 0.85 -21.13



Comment: 於2022年11月28日16:20除霜。目前無存放藥品。

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


**PHARMACY** : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

**FREEZER** : Manufacturer; PANASONIC; Model No.: MDF-U334-PT; Serial No.: 1308 0310

**THERMOMETER** : KIMO; Model No. : KTT-310; Serial No.: 1305 1667; Channel No.: 1

**FREEZER TEMPERATURE RANGE** : -15~-25°C

**DATE** : 30, Nov 2022 ~ 03, Jan 2023



## STATISTICS

#1	
Min. T	-23.28
Min. t	-23.28
Max. T	-18.56
Max. t	-18.56
Avg. T	-21.078
Avg. t	-21.078
Std dev. T	1.314
Std dev. t	1.314
MKT T	-21.085
MKT t	-21.085

T : Whole period  
t : Displayed period

Comment: 於2022年11月30日除霜完畢並於14:18重啟。目前無存放藥品。本溫度記錄器(1305 1667)於2022年11月30日完成校正。