

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1201 0861; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 29, Dec 2021 ~ 25, Jan 2022



統計表

	#1
最小 T	4.29
最小 t	4.29
最大值 T	6.57
最大值 t	6.57
平均值 T	5.237
平均值 t	5.237
標準偏差 T	0.25
標準偏差 t	0.25
MKT T	5.237
MKT t	5.237

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1201 0861; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 25, Jan 2022 ~ 24, Feb 2022



統計表

	#1
最小 T	4.67
最小 t	4.67
最大值 T	6.03
最大值 t	6.03
平均值 T	5.385
平均值 t	5.385
標準偏差 T	0.234
標準偏差 t	0.234
MKT T	5.385
MKT t	5.385

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment: 本溫度記錄器(12010861)於2022年1月25日下載溫度後送校，期間以備品溫度記錄器(14012232)暫代。 2

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


**PHARMACY :** B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

**REFRIGERATOR :** Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

**THERMOMETER :** Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1201 0861; Channel No.: 1

**FREEZER TEMPERATURE RANGE :** 2-8°C

**DATE :** 24, Feb 2022 ~ 31, Mar 2022

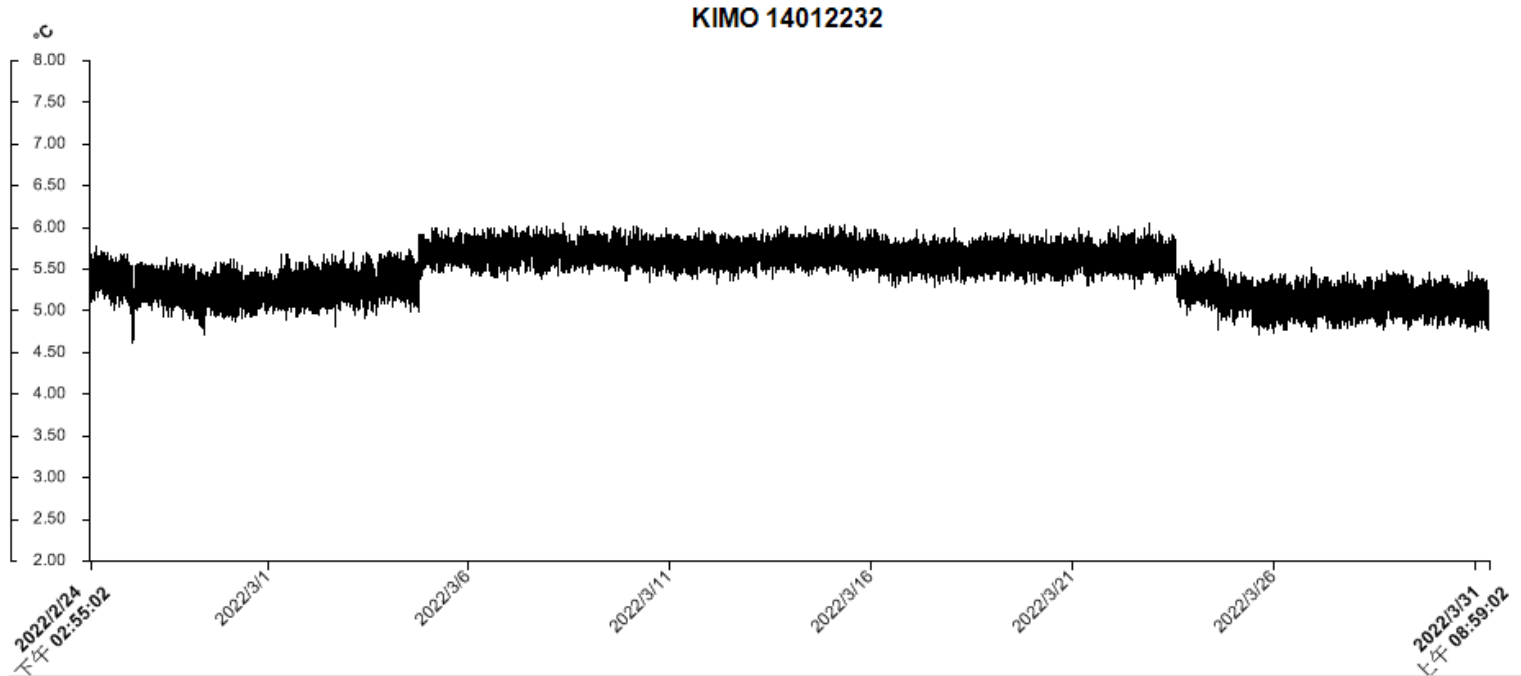

統計表

	#1
最小 T	4.62
最小 t	4.62
最大值 T	6.06
最大值 t	6.06
平均值 T	5.476
平均值 t	5.476
標準偏差 T	0.28
標準偏差 t	0.28
MKT T	5.475
MKT t	5.475

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment: 本溫度記錄器(12010861)於2022年1月25日下載溫度後送校，期間以備品溫度記錄器(14012232)暫代。 3

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1201 0861; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 31, Mar 2022 ~ 29, Apr 2022



統計表

	#1
最小 T	4.52
最小 t	4.52
最大值 T	5.84
最大值 t	5.84
平均值 T	5.075
平均值 t	5.075
標準偏差 T	0.188
標準偏差 t	0.188
MKT T	5.075
MKT t	5.075

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1201 0861; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 29, Apr 2022 ~ 19, May 2022

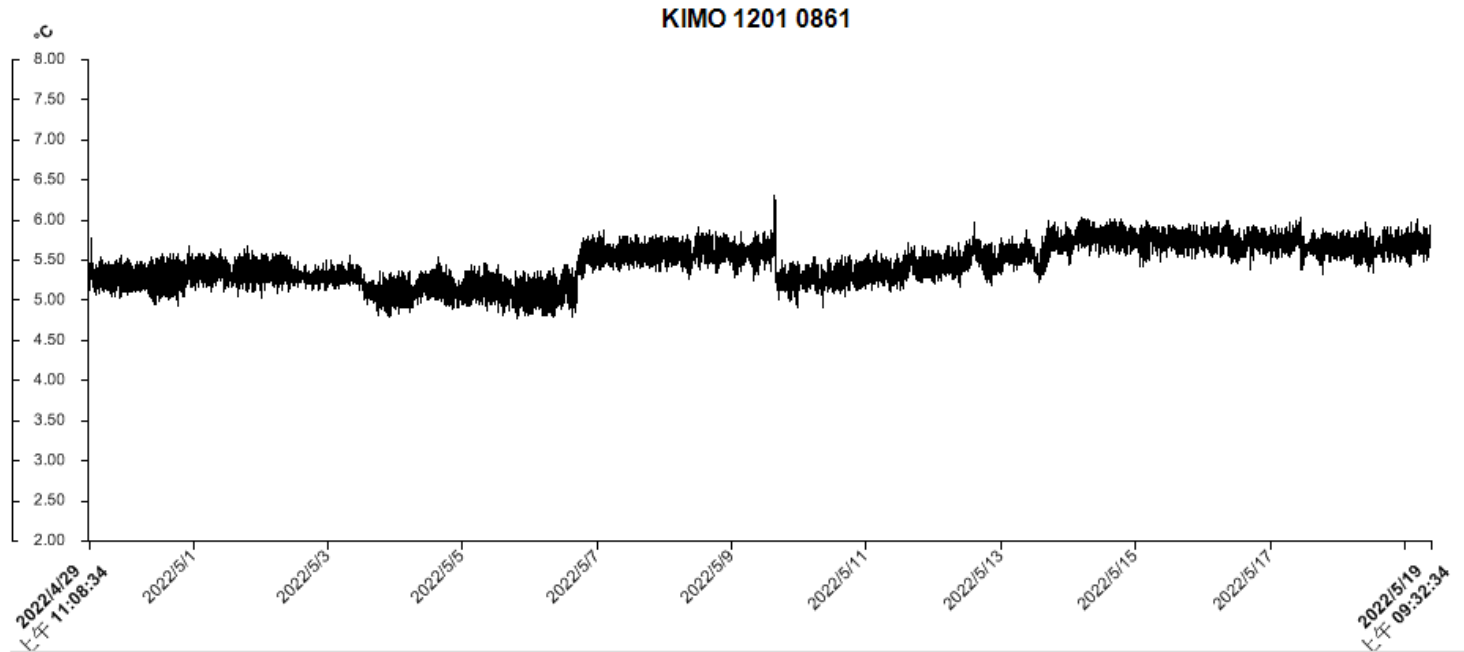

統計表

	#1
最小 T	4.78
最小 t	4.78
最大值 T	6.31
最大值 t	6.31
平均值 T	5.466
平均值 t	5.466
標準偏差 T	0.257
標準偏差 t	0.257
MKT T	5.466
MKT t	5.466

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment: 本溫度記錄器(12010861)於2022年5月19日電量顯示異常，以備品溫度記錄器(2K160903197)暫代。

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

**PHARMACY** : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

**REFRIGERATOR** : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

**THERMOMETER** : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1201 0861; Channel No.: 1


**FREEZER TEMPERATURE RANGE** : 2-8°C

**DATE** : 19, May 2022 ~ 30, May 2022



**KIMO 2K160903197**

v1 [°C]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT
4.9	6.3	5.45	0.46	5.46



Comment:本溫度記錄器(12010861)於2022年5月19日電量顯示異常，以備品溫度記錄器(2K160903197)暫代。

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


**PHARMACY** : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

**REFRIGERATOR** : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

**THERMOMETER** : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1201 0861; Channel No.: 1

**FREEZER TEMPERATURE RANGE** : 2-8°C

**DATE** : 30, May 2022 ~ 23, Jun 20



統計表

	#1
最小 T	3.97
最小 t	3.97
最大值 T	5.21
最大值 t	5.21
平均值 T	4.618
平均值 t	4.618
標準偏差 T	0.136
標準偏差 t	0.136
MKT T	4.618
MKT t	4.618

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment: 溫度記錄器於2022年6月23日更換為新品(2K210923834)。

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-220; Serial No.: 2K210923834; Channel No.: 1


FREEZER TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 23, Jun 2022 ~ 28, Jun 2022



2K210923834

v1 [°C]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT
3.9	6.3	4.21	0.13	4.22



Comment:溫度記錄器於2022年6月23日更換為新品(2K210923834)。



# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-220; Serial No.: 2K210923834; Channel No.: 1


FREEZER TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 28, Jun 2022 ~ 28, Jun 2022



2K210923834

v1 [°C]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT
4.2	7.7	5.90	0.87	5.95



Comment:於2022年6月28日更換溫度記錄器的感溫線，調整感溫探頭後重啟。

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-220-O; Serial No.: 2K210923834; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : 2-8°C


DATE : 28, Jun 2022 ~ 29, Jul 2022



2K210923834

— v1 [°C]

Min	Max	Avg	Sd	MKT
3.4	7.4	4.75	0.58	4.77



Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-220-O; Serial No.: 2K210923834; Channel No.: 1


FREEZER TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 29, Jul 2022 ~ 31, Aug 2022



2K210923834

—	v1 [°C]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT	
4.3	6.5	4.96	0.20	4.96	



Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-220-O; Serial No.: 2K210923834; Channel No.: 1

FREEZER TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 31, Aug 2022 ~ 30, Sep 2022



2K210923834

v1 [°C]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT
4.8	6.1	5.29	0.17	5.29



Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-220-O; Serial No.: 2K210923834; Channel No.: 1


FREEZER TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 30, Sep 2022 ~ 28, Oct 2022



2K210923834

v1 [°C]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT
4.6	5.8	5.25	0.16	5.25



Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-220-O; Serial No.: 2K210923834; Channel No.: 1


FREEZER TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 28, Oct 2022 ~ 30, Nov 2022



2K210923834

— v1 [°C]  
Min Max Avg Sd MKT  
3.7 6.3 5.16 0.31 5.17



Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 12110043

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-220-O; Serial No.: 2K210923834; Channel No.: 1


FREEZER TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 30, Nov 2022 ~ 03, Jan 2023



2K210923834

v1 [°C]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT
4.4	6.0	5.34	0.34	5.35



Comment: