


長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 29, Dec 2021 ~ 25, Jan 2022



統計表

	#1	#2
最小 T	20.55	50.2
最小 t	20.55	50.2
最大值 T	22.22	58.7
最大值 t	22.22	58.7
平均值 T	21.292	54.975
平均值 t	21.292	54.975
標準偏差 T	0.306	1.806
標準偏差 t	0.306	1.806
MKT T	21.291	-----
MKT t	21.291	-----

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 溫濕度記錄器(12040283/12030129)於2021年12月29日下載溫度後執行送校，期間以備品溫度記錄器(12110384/13010204)暫代

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 25, Jan 2022 ~ 15, Feb 2022

12110384/13010204

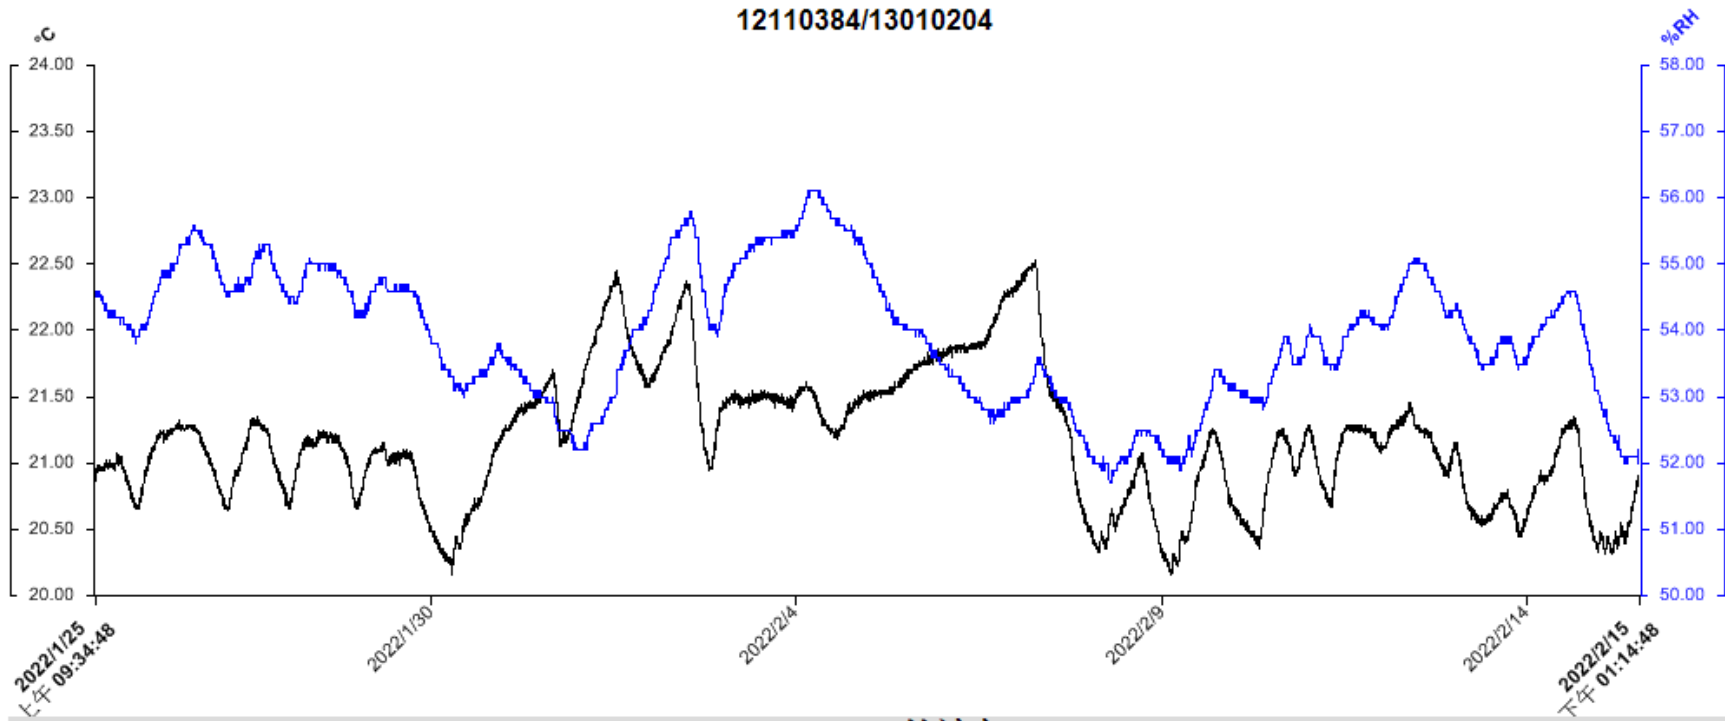

統計表

	#1	#2
最小 T	20.16	51.7
最小 t	20.16	51.7
最大值 T	22.53	56.1
最大值 t	22.53	56.1
平均值 T	21.177	53.913
平均值 t	21.177	53.913
標準偏差 T	0.495	1.025
標準偏差 t	0.495	1.025
MKT T	21.176	----
MKT t	21.176	----

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 溫濕度記錄器(12040283/12030129)於2021年12月29日下載溫度後執行送校，期間以備品溫度記錄器(12110384/13010204)暫代


長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 15, Feb 2022~ 24, Feb 2022



統計表

	#1	#2
最小 T	20.54	52.1
最小 t	20.54	52.1
最大值 T	23.25	57.6
最大值 t	23.25	57.6
平均值 T	21.305	55.278
平均值 t	21.305	55.278
標準偏差 T	0.48	1.27
標準偏差 t	0.48	1.27
MKT T	21.304	-----
MKT t	21.304	-----

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 溫濕度記錄器(12040283/12030129)於2021年12月29日下載溫度後執行送校，因無法進行溫度校正，於2022年02月15日起以備品溫濕度記錄器(12110385/13010205)暫代


長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 24, Feb 2022~ 25, Feb 2022

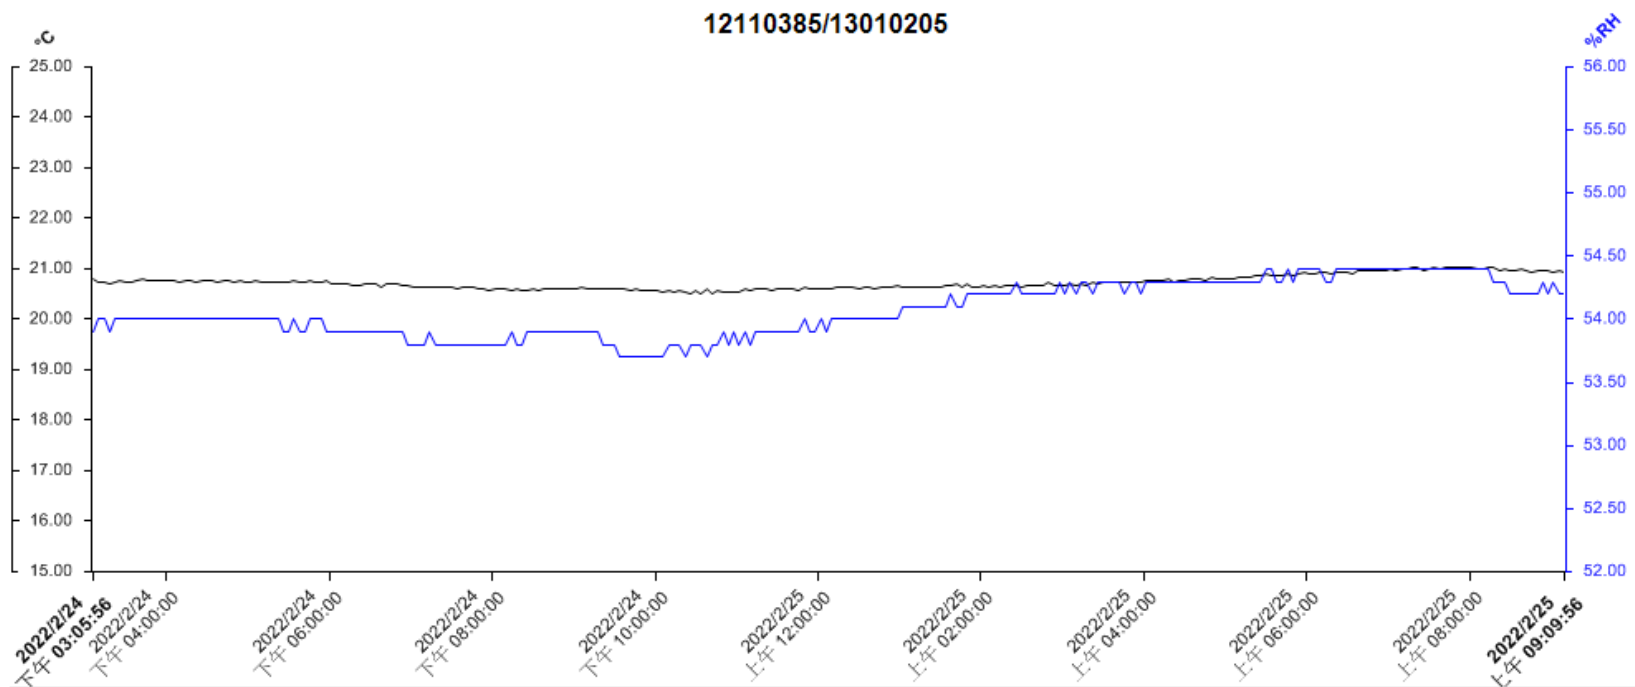

統計表

	#1	#2
最小 T	20.52	53.7
最小 t	20.52	53.7
最大值 T	21.03	54.4
最大值 t	21.03	54.4
平均值 T	20.738	54.074
平均值 t	20.738	54.074
標準偏差 T	0.136	0.215
標準偏差 t	0.136	0.215
MKT T	20.738	----
MKT t	20.738	----

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 溫濕度記錄器(12040283/12030129)於2021年12月29日下載溫度後執行送校，因無法進行溫度校正，於2022年02月15日起以備品溫濕度記錄器(12110385/13010205)暫代


長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 24, Feb 2022 ~ 31, Mar 2022



統計表

	#1	#2
最小 T	20.16	51.2
最小 t	20.16	51.2
最大值 T	22.10	56.8
最大值 t	22.10	56.8
平均值 T	21.064	54.5
平均值 t	21.064	54.5
標準偏差 T	0.31	1.062
標準偏差 t	0.31	1.062
MKT T	21.063	-----
MKT t	21.063	-----

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 溫濕度記錄器(12040283/12030129)於2021年12月29日下載溫度後執行送校，因無法進行溫度校正，於2022年02月15日起以備品溫濕度記錄器(12110385/13010205)暫代，又因備品溫濕度記錄器(12110385/13010205)電池耗盡，於2022年02月25日改以另一備品溫濕度記錄器(12110384/13010204)替代


長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 31, Mar 2022 ~ 29, Apr 2022

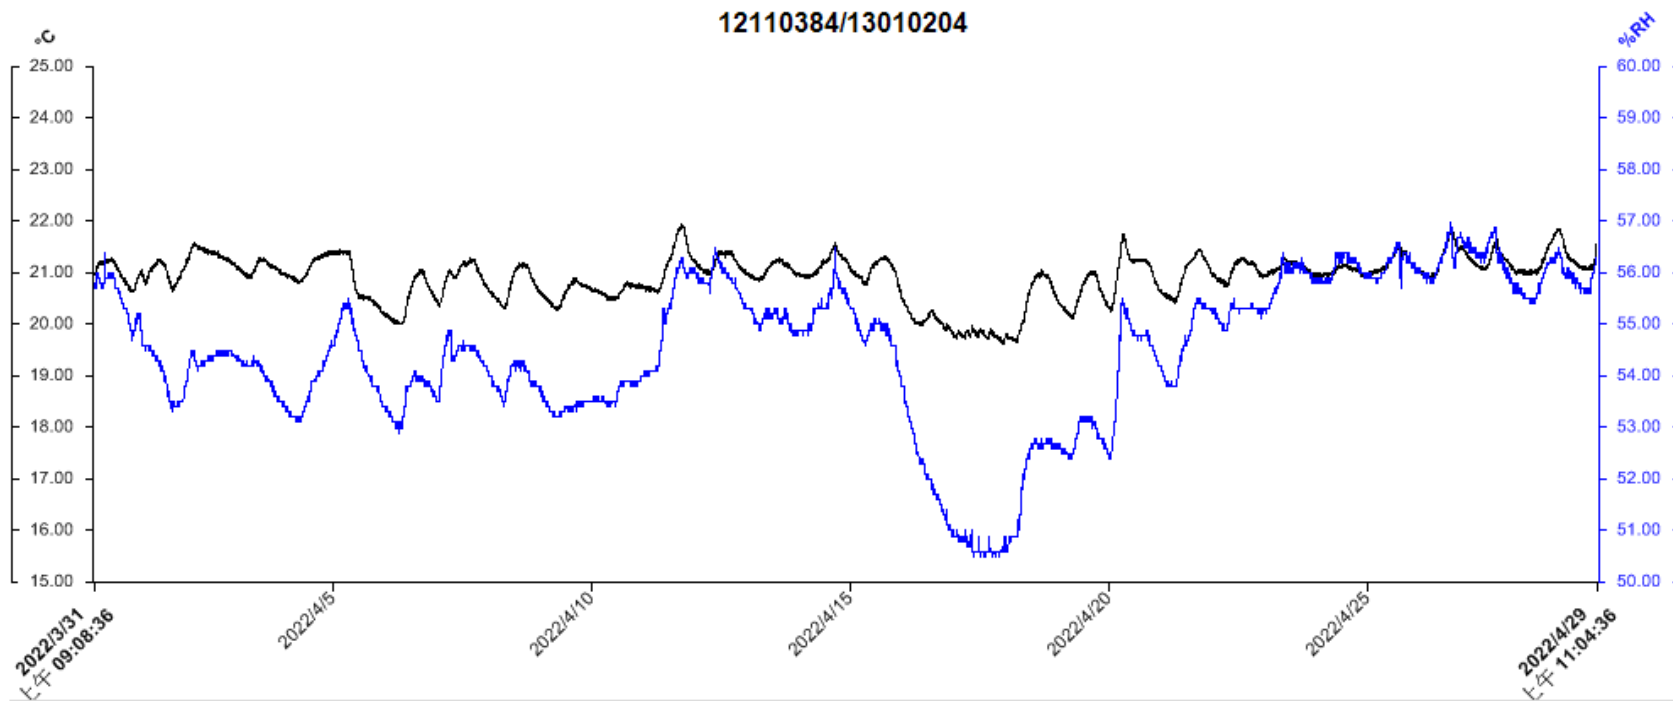

統計表

	#1	#2
最小 T	19.61	50.5
最小 t	19.61	50.5
最大值 T	21.94	57.0
最大值 t	21.94	57.0
平均值 T	20.919	54.507
平均值 t	20.919	54.507
標準偏差 T	0.438	1.429
標準偏差 t	0.438	1.429
MKT T	20.918	-----
MKT t	20.918	-----

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 溫濕度記錄器(12040283/12030129)故障待換新，以備品溫濕度記錄器(12110384/13010204)暫代


長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 29, Apr 2022 ~ 19, May 2022



統計表

	#1	#2
最小 T	20.04	54.9
最小 t	20.04	54.9
最大值 T	22.29	63.3
最大值 t	22.29	63.3
平均值 T	21.019	59.518
平均值 t	21.019	59.518
標準偏差 T	0.496	1.978
標準偏差 t	0.496	1.978
MKT T	21.018	-----
MKT t	21.018	-----

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 溫濕度記錄器(12040283/12030129)故障待換新，原暫代之備品溫濕度記錄器(12110384/13010204)於2022年5月19日換下送校，送校期間以備品(12110385/13010205)暫代。


長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 19, May 2022 ~ 30, May 2022



統計表

	#1	#2
最小 T	20.68	61.6
最小 t	20.68	61.6
最大值 T	22.55	63.5
最大值 t	22.55	63.5
平均值 T	21.671	62.282
平均值 t	21.671	62.282
標準偏差 T	0.407	0.392
標準偏差 t	0.407	0.392
MKT T	21.67	-----
MKT t	21.67	-----

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 溫濕度記錄器(12040283/12030129)故障待換新，原暫代之備品溫濕度記錄器(12110384/13010204)換下送校，送校期間以備品(12110385/13010205)暫代。


長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 30, May 2022 ~ 23, Jun 2022



統計表

	#1	#2
最小 T	19.16	59.4
最小 t	19.16	59.4
最大值 T	23.13	65.5
最大值 t	23.13	65.5
平均值 T	21.079	61.991
平均值 t	21.079	61.991
標準偏差 T	0.807	1.274
標準偏差 t	0.807	1.274
MKT T	21.077	----
MKT t	21.077	----

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: 溫濕度記錄器(12040283/12030129)故障待換新，原暫代之備品溫濕度記錄器(12110384/13010204)換下送校，送校期間以備品(12110385/13010205)暫代。

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KT-220-O ; Serial No.: 2K210522817/4K210513557

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C


DATE : 23, Jun 2022 ~ 24, Jun 2022



2K210522817

v1 [°C]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT
19.8	21.7	20.39	0.49	20.41

v2 [%RH]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT
61.2	63.1	61.85	0.54	---

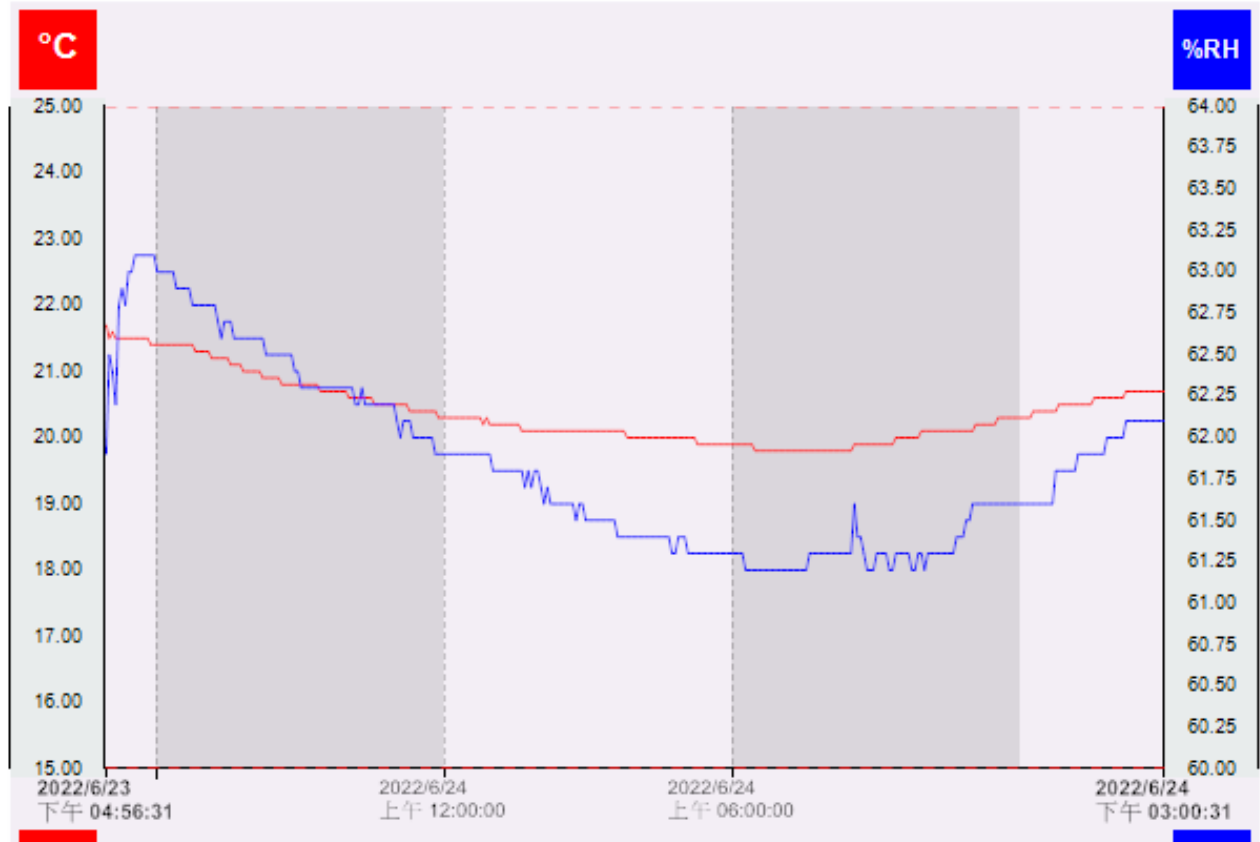

Comment:溫濕度記錄器於2022年6月23日更換為新品(2K210522817/4K210513557)，於2022年6月24日調整溼度測量棒後重啟。

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KT-220-O ; Serial No.: 2K210522817/4K210513557

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C


DATE : 24, Jun 2022 ~ 28, Jun 2022



2K210522817

v1 [°C]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT
20.3	21.9	21.20	0.42	21.21

v2 [%RH]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT
61.9	64.7	63.50	0.83	—

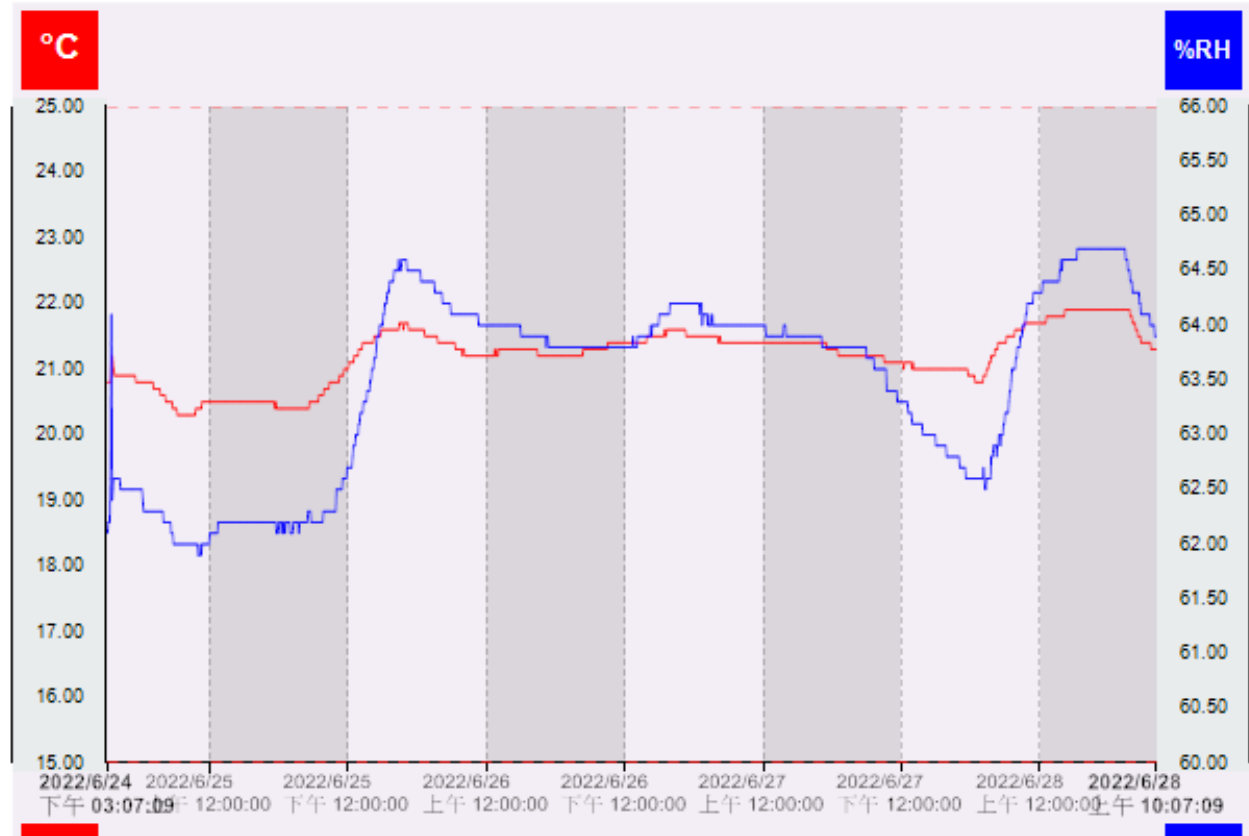

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KT-220-O ; Serial No.: 2K210522817/4K210513557


ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 28, Jun 2022 ~ 29, Jul 2022



2K210522817

— v1 [°C]					
Min	Max	Avg	Sd	MKT	
20.2	23.1	21.65	0.57	21.67	
— v2 [%RH]					
Min	Max	Avg	Sd	MKT	
58.8	65.2	61.78	1.28	---	



Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KT-220-O ; Serial No.: 2K210522817/4K210513557


ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 29, Jul 2022 ~ 31, Aug 2022



2K210522817

— v1 [°C]					
Min	Max	Avg	Sd	MKT	
20.1	22.0	21.00	0.37	21.01	
— v2 [%RH]					
Min	Max	Avg	Sd	MKT	
58.3	61.6	59.41	0.57	---	



Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KT-220-O ; Serial No.: 2K210522817/4K210513557


ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 31, Aug 2022 ~ 30, Sep 2022



2K210522817

— v1 [°C]					
Min	Max	Avg	Sd	MKT	
20.9	23.2	22.24	0.44	22.25	
— v2 [%RH]					
Min	Max	Avg	Sd	MKT	
58.3	63.6	61.16	1.02	---	



Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KT-220-O ; Serial No.: 2K210522817/4K210513557

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C


DATE : 30, Sep 2022 ~ 28, Oct 2022



2K210522817

v1 [°C]					
Min	Max	Avg	Sd	MKT	
19.9	22.9	21.08	0.66	21.10	

v2 [%RH]					
Min	Max	Avg	Sd	MKT	
63.1	69.6	65.30	1.34	---	



Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KT-220-O ; Serial No.: 2K210522817/4K210513557


ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 28, Oct 2022 ~ 30, Nov 2022



2K210522817

— v1 [°C]					
Min	Max	Avg	Sd	MKT	
20.5	22.8	21.31	0.36	21.31	
— v2 [%RH]					
Min	Max	Avg	Sd	MKT	
66.4	70.6	68.58	0.69	---	



Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KT-220-O ; Serial No.: 2K210522817/4K210513557


ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 30, Nov 2022 ~ 03, Jan 2023



2K210522817

v1 [°C]					
Min	Max	Avg	Sd	MKT	
18.5	23.0	20.69	0.65	20.71	
v2 [%RH]					
Min	Max	Avg	Sd	MKT	
50.2	69.4	63.38	5.46	---	



Comment: