

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 03, Jan 2023 ~ 17, Jan 2023



統計表

#1	
最小 T	4.61
最小 t	4.61
最大值 T	6.04
最大值 t	6.04
平均值 T	5.14
平均值 t	5.14
標準偏差 T	0.22
標準偏差 t	0.22
MKT T	5.14
MKT t	5.14

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 17, Jan 2023 ~ 17, Jan 2023


- 登出系統
- 回主畫面
- 變更密碼
- 電子地圖
- 例行檢閱
- 統計圖表
 - log資料查詢(有圖)
 - log資料查詢(沒圖)
 - 溫度異常統計
- 系統管理

統計圖表 > log資料查詢

組別: 臨床試驗藥局 ; 設備: 臨床試驗藥局 冷藏2 ; 可容許上下限值: 2.5 ~ 7.5

最小值: 6.0 ; 最大值: 7.1 ; 平均值: 6.46

時間範圍: 2023-01-17 00:00:00 ~ 2023-01-17 23:45:00 ; 取樣率: 1 : 1

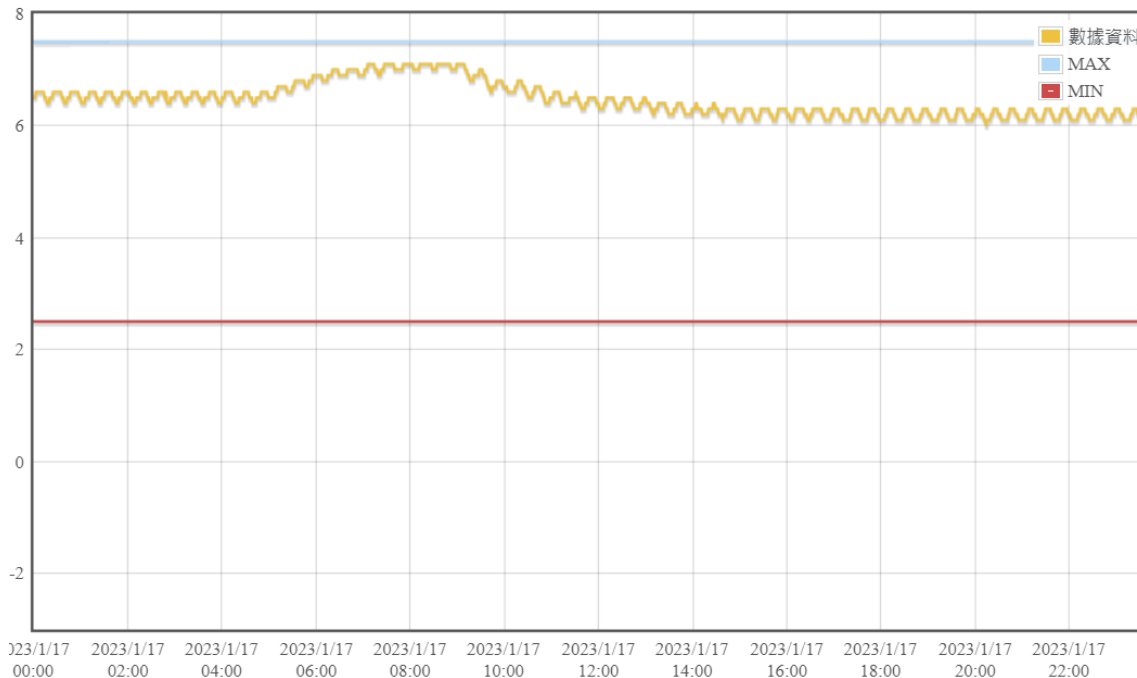

Comment: 溫度記錄器於2023年1月17日14:43~16:43故障未測到資料，故以長庚溫控網溫度記錄佐證。

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.


REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 17, Jan 2023 ~ 18, Jan 2023

KIMO 1305 1583



統計表

	#1
最小 T	4.79
最小 t	4.79
最大值 T	5.51
最大值 t	5.51
平均值 T	5.12
平均值 t	5.12
標準偏差 T	0.125
標準偏差 t	0.125
MKT T	5.12
MKT t	5.12

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 18, Jan 2023 ~ 30, Jan 2023



統計表

#1	
最小 T	4.73
最小 t	4.73
最大值 T	5.54
最大值 t	5.54
平均值 T	5.12
平均值 t	5.12
標準偏差 T	0.097
標準偏差 t	0.097
MKT T	5.12
MKT t	5.12

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 30, Jan 2023 ~ 01, Mar 2023



統計表

#1	
最小 T	4.19
最小 t	4.19
最大值 T	5.97
最大值 t	5.97
平均值 T	4.921
平均值 t	4.921
標準偏差 T	0.276
標準偏差 t	0.276
MKT T	4.92
MKT t	4.92

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 01, Mar 2023 ~ 31, Mar 2023



統計表

#1	
最小 T	3.58
最小 t	3.58
最大值 T	5.76
最大值 t	5.76
平均值 T	4.368
平均值 t	4.368
標準偏差 T	0.308
標準偏差 t	0.308
MKT T	4.367
MKT t	4.367

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 31, Mar 2023 ~ 28, Apr 2023



統計表

	#1
最小 T	3.84
最小 t	3.84
最大值 T	5.64
最大值 t	5.64
平均值 T	4.975
平均值 t	4.975
標準偏差 T	0.223
標準偏差 t	0.223
MKT T	4.975
MKT t	4.975

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 28, Apr 2023 ~ 29, May 2023



統計表

#1	
最小 T	4.06
最小 t	4.06
最大值 T	6.88
最大值 t	6.88
平均值 T	4.794
平均值 t	4.794
標準偏差 T	0.246
標準偏差 t	0.246
MKT T	4.794
MKT t	4.794

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.


REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 29, May 2023 ~ 30, Jun 2023

KIMO 1305 1583



統計表

	#1
最小 T	4.02
最小 t	4.02
最大值 T	5.61
最大值 t	5.61
平均值 T	4.532
平均值 t	4.532
標準偏差 T	0.14
標準偏差 t	0.14
MKT T	4.532
MKT t	4.532

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-220-O; Serial No.: 1D220605896; Channel No.: 1


REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 30, Jun 2023 ~ 31, Jul 2023



1D220605896

v1 [°C]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT
4.2	6.3	4.75	0.20	4.75



Comment: 本溫度記錄器(1305 1583)於2023年6月30日送校，期間以備品溫度記錄器(1D220605896)暫代。

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-220-O; Serial No.: 1D220605896; Channel No.: 1


REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 31, Jul 2023 ~ 11, Aug 2023



1D220605896

v1 [°C]				
Min	Max	Avg	Sd	MKT
4.6	5.5	4.96	0.13	4.96

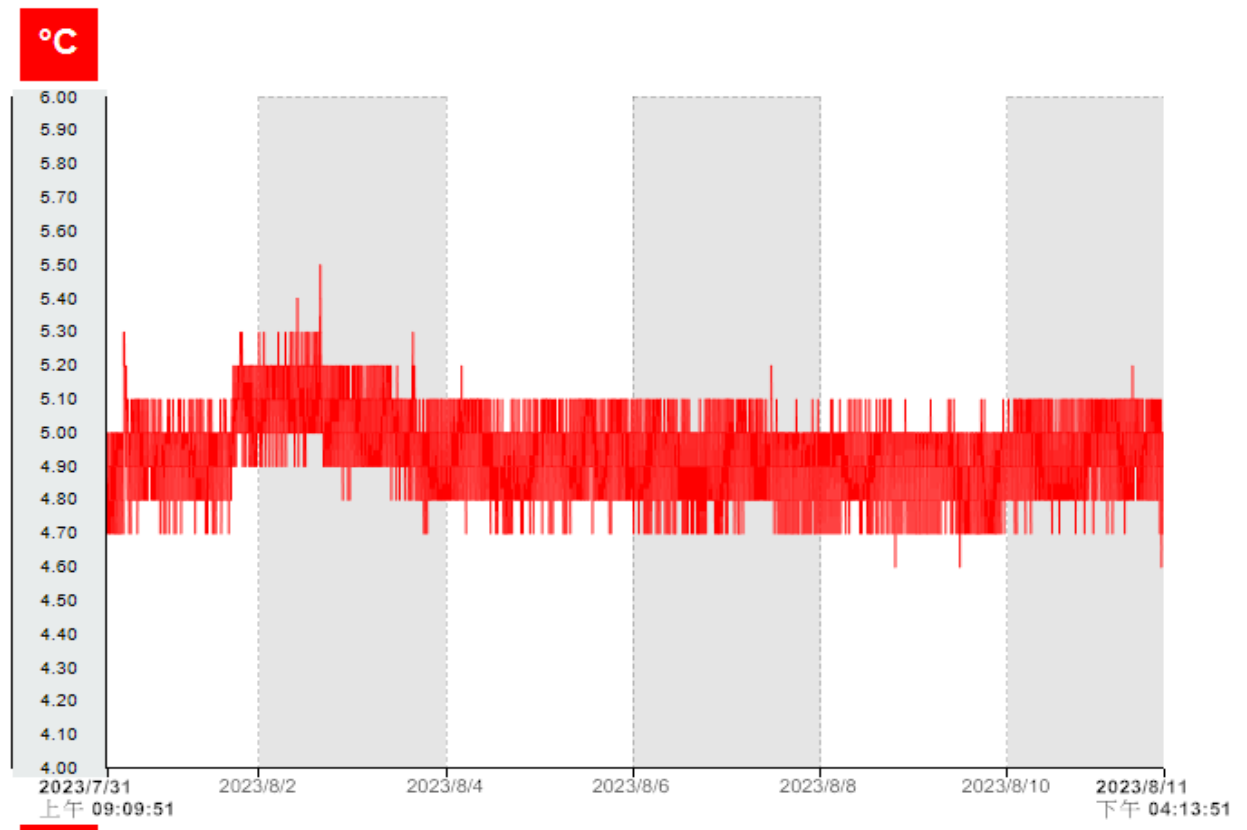

Comment:本溫度記錄器(1305 1583)完成校正，於2023年8月11日換回使用。

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 11, Aug 2023 ~ 01, Sep 2023



統計表

	#1
最小 T	4.56
最小 t	4.56
最大值 T	5.90
最大值 t	5.90
平均值 T	5.094
平均值 t	5.094
標準偏差 T	0.176
標準偏差 t	0.176
MKT T	5.093
MKT t	5.093

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:本溫度記錄器(1305 1583)完成校正，於2023年8月11日換回使用。

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-220-O; Serial No.: 2K210322159; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C


DATE : 01, Sep 2023 ~ 01, Sep 2023



2K210322159

— v2 channel 2 [°C]

Min	Max	Avg	Sd	MKT
3.8	5.4	4.37	0.46	4.39

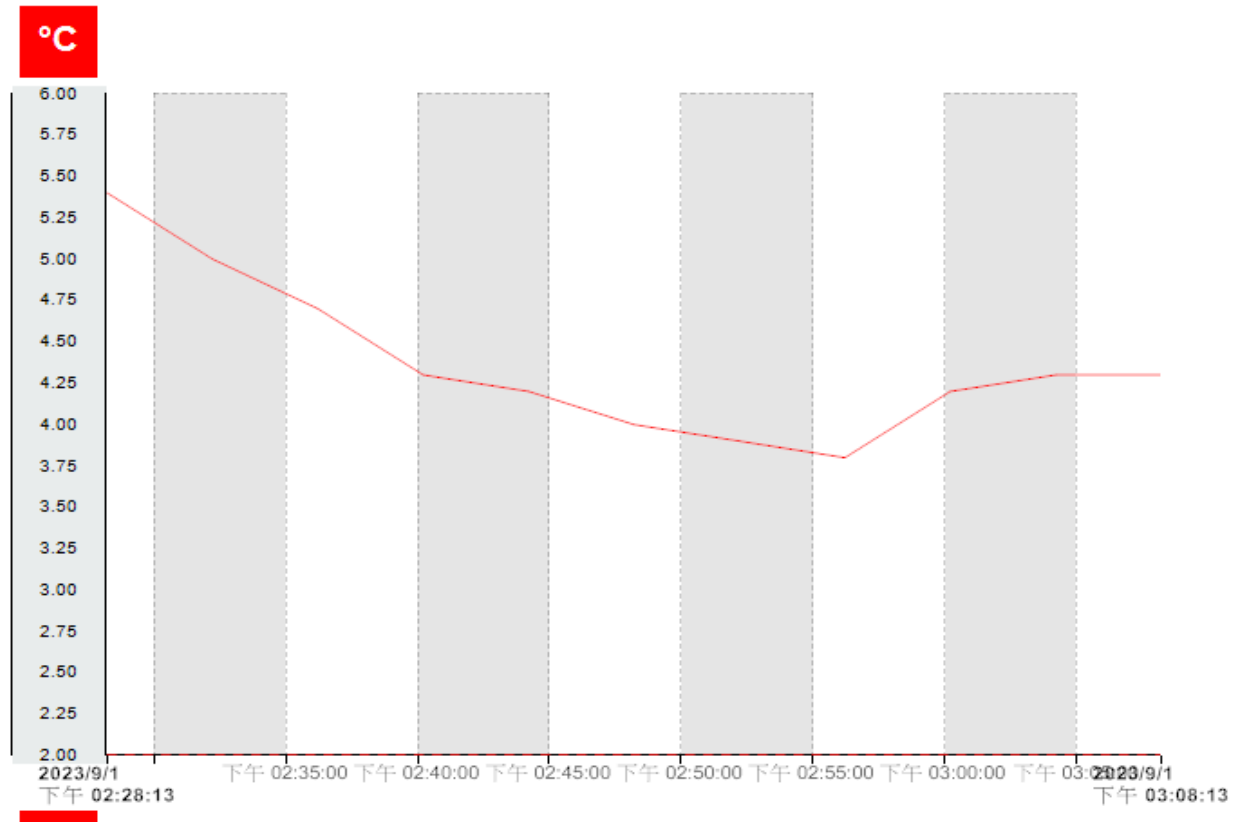

Comment: 於2023年9月1日14:28~15:08更換溫度記錄器的感溫線，期間以備品溫度記錄器(2K210322159)暫代。 13

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 01, Sep 2023 ~ 28, Sep 2023



統計表

#1	
最小 T	2.68
最小 t	2.68
最大值 T	6.04
最大值 t	6.04
平均值 T	4.846
平均值 t	4.846
標準偏差 T	0.387
標準偏差 t	0.387
MKT T	4.845
MKT t	4.845

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.


REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 28, Sep 2023 ~ 31, Oct 2023

KIMO 1305 1583



統計表

	#1
最小 T	4.73
最小 t	4.73
最大值 T	6.45
最大值 t	6.45
平均值 T	5.365
平均值 t	5.365
標準偏差 T	0.169
標準偏差 t	0.169
MKT T	5.365
MKT t	5.365

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 31, Oct 2023 ~ 30, Nov 2023



統計表

	#1
最小 T	4.20
最小 t	4.20
最大值 T	5.81
最大值 t	5.81
平均值 T	4.977
平均值 t	4.977
標準偏差 T	0.221
標準偏差 t	0.221
MKT T	4.977
MKT t	4.977

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment:

長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

REFRIGERATOR : Manufacturer: PANASONIC; Model No.: MPR-1014R-PT; Serial No.: 15120037

THERMOMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTT-310; Serial No.: 1305 1583; Channel No.: 1

REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE : 2-8°C

DATE : 30, Nov 2023 ~ 29, Dec 2023



統計表

	#1
最小 T	4.19
最小 t	4.19
最大值 T	5.69
最大值 t	5.69
平均值 T	5.058
平均值 t	5.058
標準偏差 T	0.215
標準偏差 t	0.215
MKT T	5.058
MKT t	5.058

T: 整個週期
t: 顯示週期

Comment: